




製品返送ルールとお願い

Boston
Scientific

- 返送前に以下6つのポイントを必ずチェック願います
- 返送内容に変更がある場合は、製品の返送前に弊社お客様センター(TEL 0120-414566)へご一報ください


※ 返送伝票には2種類ございます:短期貸出返却=短期貸出使用・返却報告書, 買取返品/長期貸出返却=商品返送依頼書

返送伝票※に記載された製品すべてが揃っていますか?

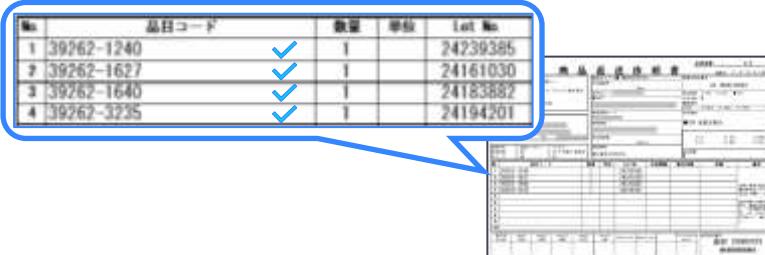

返送伝票※を同梱されていますか?

特にご注意ください

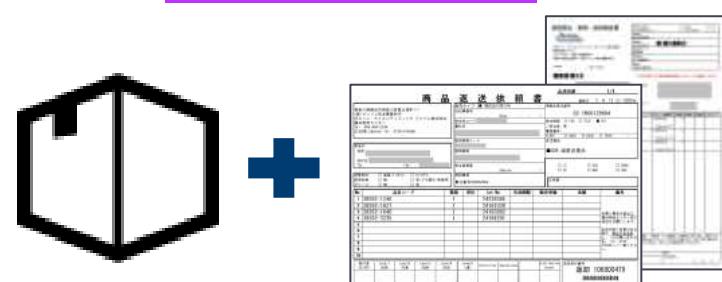

製品と伝票の数量・ロットは一致していますか?



数量	単位	Lot No.
1		24239385
1		24161030

「短期貸出使用・返却報告書」の返却数/使用数にお間違いや記入漏れはないですか?

カタログ番号	商品名	ロット・有効期限	返却数	使用数	返却数
M00520420	エンドビブ ボタンII 2042	20E0424 *2023-05-31	1	1	
M00520430	エンドビブ ボタンII 2043	20F0363 *2023-05-31	1		1

OK




特にご注意ください

「商品返送依頼書」右下の“返送受付番号”欄に返送受付番号が記載されていますか?



開封済製品が混在してないですか?



開封された形跡がある場合は、製品の安全性が担保できません