

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

**Netzwerk und Konnektivität**

Anwendung zur Verwendung mit dem  
LATITUDE™ Programmiersystem

**REF 3924** Netzwerk und Konnektivität

**REF 3300** LATITUDE™ Programmiersystem

рсия. Да не се използва.  
erze. Nepoužívajte.  
version. Må ikke anvendes.  
n überholt. Nicht verwenden.  
unud version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreлт útгáфа. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.  
Zastarana verzija. Nepoužívajte.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd  
ancel olmayan sürüm. K

# INHALTSVERZEICHNIS

GEBRAUCHSANWEISUNG .....	1
Informationen zu Marken .....	1
Beschreibung und Verwendung .....	1
Einsatzbereiche .....	1
Zielgruppe .....	1
Erforderliche Kompetenzen und Fachwissen .....	1
Medizinprodukte-Betreiberverordnung .....	2
Kontraindikationen .....	2
WARNHINWEISE .....	2
Vorsichtsmaßnahmen .....	3
Softwareaktualisierungen und -Downloads .....	4
Netzwerke und Konnektivität .....	4
Netzwerk-konnektivität .....	5
Ethernet und Wi-Fi .....	5
Bluetooth® .....	6
USB .....	6
Optionale externe Geräte .....	7
Externer Drucker .....	7
DisplayPort für einen externen Monitor .....	7
ANSCHLÜSSE .....	8
Seitliches Bedienfeld für Ärzte (linke Seite) .....	8
VERWENDEN VON NETZWERK- UND KONNEKTIVITÄTSFUNKTIONEN .....	9
Kabelanschlüsse für Netzwerk und Konnektivität .....	9
Einrichten von Netzwerken und Konnektivität .....	10
Die Taste „Dienstprogramme“ .....	10
Registerkarte „Einrichten des Netzwerks“ – Übersicht .....	11
Wireless(Wi-Fi)-Konnektivität .....	11
Bluetooth®-Konnektivität .....	14
Ethernet-Konnektivität .....	17
WARTUNG .....	19
SICHERHEIT DES PROGRAMMIERSYSTEMS .....	19
Netzwerksicherheit .....	20
Physikalische Kontrollen .....	20
Beeinträchtigtes Programmiergerät Modell 3300 .....	20
SPEZIFIKATIONEN .....	21
GARANTIE .....	21

рсия. Да не се използва.  
erze. Nepoužívajte.  
version. Må ikke anvendes.  
n überholt. Nicht verwenden.  
n version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreлт útгáфа. Notið ekki.  
Versione obsolete. Non utilizzare.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.  
Zastarana verzija. Nepoužívajte.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd  
ancel olmayan sürüm. K

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## Informationen zu Marken

Die Folgenden sind Marken der Boston Scientific Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften: LATITUDE, LATITUDE Link und Quick Start.

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG.

DisplayPort ist eine Marke der Video Electronics Standards Association (VESA).

## Beschreibung und Verwendung

Die Netzwerkanwendung des LATITUDE™-Programmiersystems bietet Ethernet- und Wireless-Konnektivität zum Software-Download, Bluetooth®-Konnektivität zur Datenübertragung sowie Bluetooth®- und USB-Konnektivität zum Drucken. Das LATITUDE™ Programmiersystem Modell 3300 ist ein portables System zum Management des Herzrhythmus zur Verwendung mit Systemen von Boston Scientific, z. B. implantierbaren Aggregaten (PG) und Elektroden.

**HINWEIS:** *Die in diesem Handbuch verwendeten Bildschirmbilder dienen Darstellungszwecken und stimmen möglicherweise nicht exakt mit Ihren Bildschirmansichten überein.*

### Einsatzbereiche

Das LATITUDE Programmiersystem ist für die Verwendung in Krankenhaus- und klinischen Umgebungen für die Kommunikation mit implantierbaren Systemen von Boston Scientific gedacht. Die verwendete Software steuert alle Kommunikationsfunktionen für das Aggregat. Ausführliche Anweisungen für die Softwareanwendung finden Sie in der Produktdokumentation, die dem abzufragenden Aggregat beigelegt ist.

### Zielgruppe

Das Programmiergerät Modell 3300 ist für medizinische Fachkräfte vorgesehen, die in der Implantation von Geräten und/oder in der Durchführung von Nachsorgeverfahren geschult wurden oder darin erfahren sind.

### Erforderliche Kompetenzen und Fachwissen

Die Benutzer müssen sich mit dem Verfahren der Elektrotherapie des Herzens sehr gut auskennen. Nur qualifizierte Fachärzte, die über das Spezialwissen verfügen, das für die ordnungsgemäße Verwendung des Geräts erforderlich ist, dürfen das Verfahren anwenden.

### Ärztliche Überwachung

Das LATITUDE-Programmiersystem darf nur unter konstanter ärztlicher Überwachung bedient werden. Während des Verfahrens muss der Patient fortlaufend durch medizinisches Personal mithilfe eines Oberflächen-EKGs überwacht werden.

## Medizinprodukte-Betreiberverordnung

Einige nationale Vorschriften schreiben vor, dass vom Benutzer, Hersteller oder einem Vertreter des Herstellers während der Installation Sicherheitstests am Gerät durchgeführt und dokumentiert werden. Zusätzlich kann erforderlich sein, dass der Hersteller oder ein Vertreter des Herstellers Schulungen zur ordnungsgemäßen Verwendung des Geräts und Zubehörs anbietet.

Sollten Sie die nationalen Vorschriften Ihres Landes nicht kennen, wenden Sie sich bitte an den nächsten Boston Scientific-Vertreter.

## Kontraindikationen

Das LATITUDE-Programmiersystem ist nicht für die Verwendung mit Aggregaten vorgesehen, die nicht mit dem Boston Scientific-Aggregat kompatibel sind.

Die Netzwerk- und Konnektivitätsanwendung ist kontraindiziert für die Verwendung mit einem anderen Programmiersystem als dem Boston Scientific Modell 3300 LATITUDE™-Programmiersystem.

Informationen zu den Kontraindikationen bezüglich der Verwendung mit einem Aggregat finden Sie in der Produktdokumentation, die dem abgefragten Aggregat beigelegt ist.

## WARNHINWEISE

Weitere Warnhinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung für das LATITUDE-Programmiersystem Modell 3300.



### **Verwendung von nicht angegebenen Kabeln und Zubehörteilen.**

Die Verwendung von Kabeln oder Zubehörteilen mit dem LATITUDE-Programmiersystem, die nicht von Boston Scientific mitgeliefert oder angegeben werden, könnte zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen, verringerter elektromagnetischer Störsicherheit oder elektrischem Schock beim LATITUDE-Programmiersystem führen. Jede Person, die derartige Kabel oder Zubehörteile an das LATITUDE Programmiersystem anschließt (dies gilt auch für die Verwendung von Mehrfachsteckdosen), konfiguriert damit ein medizinisches System und trägt die Verantwortung dafür, dass dieses System die Anforderungen der Norm IEC/EN 60601-1, Klausel 16 für medizinische elektrische Geräte erfüllt.



**Steckerverbindungen.** Berühren Sie nicht gleichzeitig den Patienten und zugängliche Stecker oder freigelegte Leiter des LATITUDE-Programmiersystems.



**Standort des Programmiersystems.** Die Verwendung dieses Geräts neben oder aufgestapelt auf andere Geräte sollte vermieden werden, da dies den Betrieb beeinträchtigen könnte. Wenn der Betrieb unter solchen Bedingungen erforderlich ist, sollte dieses Gerät und auch die anderen Geräte beobachtet werden, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.



**Gerätemodifikationen.** Modifizierungen an diesem Gerät müssen von Boston Scientific genehmigt werden.

## Vorsichtsmaßnahmen

Weitere Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Gebrauchsanweisung für das *LATITUDE Programmiersystem Modell 3300*.

- **Leckstrom.** Es kann sein, dass optionale externe Geräte, die an das Programmiergerät Modell 3300 angeschlossen werden, die geltenden Anforderungen für im Handel erhältliche Produkte hinsichtlich Ableitströmen erfüllen, die strengeren Anforderungen für medizinische Produkte hinsichtlich Ableitströmen jedoch nicht. Daher müssen sämtliche externen Geräte außerhalb des Patientenbereichs verbleiben.
  - Berühren Sie niemals gleichzeitig die elektrischen Kontakte an den Seitenflächen des Programmiergeräts Modell 3300 und den Patienten einen Programmierkopf oder ein Kabel.
- **Ethernet.** Falls Sie es nutzen möchten, verbinden Sie das Ethernet-Kabel nur mit dem RJ45-Ethernet-Port-Anschluss auf dem Programmiergerät Modell 3300. Das Verbinden oder Entfernen des Ethernet-Kabels während des Betriebs kann die Netzwerkfunktionen beeinträchtigen. Die RJ45-Ethernet-Verbindung auf dem Programmiergerät Modell 3300 ist nur für die Verwendung über lokale Netzwerke (LAN). Das Gerät darf nicht über eine Telefonverbindung verwendet werden.
- **USB-Geräte.** An das Programmiergerät angeschlossene USB-Geräte sollten kontrolliert werden, um die mögliche Infizierung von Schadsoftware zu begrenzen.
- **Software.** Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellsten Software-Versionen installiert haben. Als Backup kann Ihnen Ihr Boston Scientific-Vertreter vor Ort Softwareaktualisierungen über einen USB-Stick zur Verfügung stellen.
- **Einschalten des Systems.** Boston Scientific empfiehlt, vor dem Einschalten des Programmiergeräts Modell 3300 alle erforderlichen Kabel und Geräte anzuschließen.

# Softwareaktualisierungen und -Downloads

Softwareaktualisierungen und -Downloads werden über das Internet oder einen USB-Stick zur Verfügung gestellt.

Die Registerkarte „Dienstprogramme“ auf dem Bildschirm des Programmiergeräts Modell 3300 umfasst eine Auswahloption für eine Softwareaktualisierung. Der Benutzer kann entweder alle Aktualisierungen herunterladen und installieren oder die verfügbaren Aktualisierungen prüfen und auswählen.


Weitere Informationen zum Herunterladen und Installieren von Softwareaktualisierungen finden Sie in der *Gebrauchsanweisung zum LATITUDE-Programmiersystem Modell 3300*.

Ein Verlust der Netzwerkonnektivität kann zu Verzögerungen beim Installieren von Softwareaktualisierungen führen und indirekt die Vorteile der Aktualisierung im Zusammenhang mit der Funktion des Programmiergeräts Modell 3300, dem PSA-Gerät oder dem Aggregat beeinträchtigen. Als Backup kann Ihnen Ihr Boston Scientific-Vertreter vor Ort Softwareaktualisierungen über einen USB-Stick zur Verfügung stellen.

## Netzwerke und Konnektivität

Das LATITUDE-Programmiersystem bietet Ethernet- und Wireless-Konnektivität für den Software-Download. Zur Datenübertragung und zum Drucken steht Bluetooth®-Konnektivität zur Verfügung. Eine Darstellung der möglichen Netzwerkverbindungen finden Sie in Abbildung 1.

Vor der Geräteabfrage lesen Sie unter „Verwenden von Netzwerk- und Konnektivitätsfunktionen“ auf Seite 9 nach, um eine Verbindung herzustellen und Netzwerk- und Konnektivitätsfunktionen zu konfigurieren.

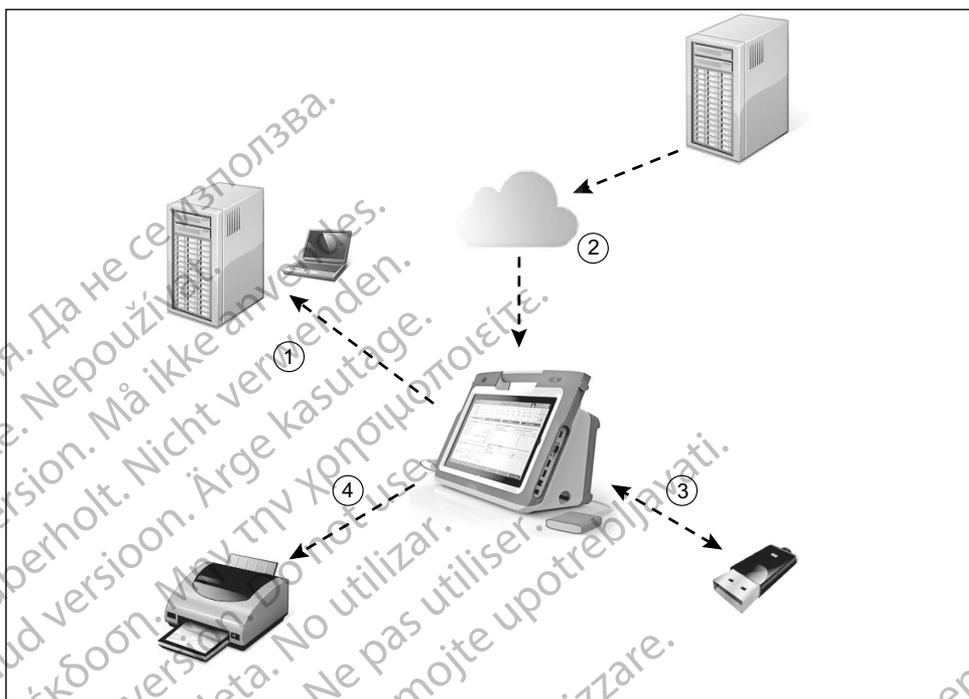

[1] Datenübertragung mit Bluetooth® [2] Software-Download für das Programmiergerät Modell 3300 von BSC über das Internet mittels Ethernet oder Wi-Fi; [3] Datenübertragung – Aktualisierung der Software für das Programmiergerät Modell 3300 über USB; [4] Berichtdruck über Bluetooth® oder ein USB-Kabel

**Abbildung 1. Übersicht über Netzwerke**

## Netzwerkconnectivität

Das LATITUDE-Programmiersystem bietet Ethernet-, Wi-Fi-, Bluetooth-® und USB-Konnektivität.

### Ethernet und Wi-Fi

Die Verbindung zu einem IT-Netzwerk ermöglicht einen Informationsfluss zwischen dem Programmiergerät Modell 3300, dem Netzwerk und den Geräten im Netzwerk. Die Netzwerkconnectivität wird verwendet, um Software von einem sicheren Boston Scientific-Server herunterzuladen und das Datum und die Uhrzeit der integrierten Uhr des Programmiergeräts Modell 3300 zu synchronisieren. Software-Downloads werden von einem Boston Scientific-Server abgerufen, über das Internet übermittelt und von der Ethernet- oder WiFi-Verbindung des LATITUDE-Programmiersystems empfangen.

## Netzwerkverlust

Hier finden Sie einige Fehlerbehebungsmaßnahmen für den Fall, dass das Netzwerk ausfällt (Ethernet oder Wi-Fi) und Sie keine Verbindung mehr herstellen können, wenn das Netzwerk wieder funktioniert:

- Entfernen Sie zum Wiederherstellen der Wi-Fi-Netzwerkfunktionen das Ethernet-Kabel, und starten Sie die Wi-Fi-Aktivität neu.
- Schließen Sie zum Wiederherstellen der Ethernet-Netzwerkfunktionen das Ethernet-Kabel wieder an, und starten Sie die Ethernet-Aktivität neu.
- Wenn das Ethernet-Kabel entfernt oder angeschlossen wird, während eine Netzwerkfunktion aktiv ist (Download oder Datenübertragung), wird diese Netzwerkfunktion abgebrochen und nicht abgeschlossen.
- Zur Wiederherstellung eines unvollständigen Software-Downloads prüfen Sie den Netzwerkstatus und die Verbindung, und versuchen Sie den Download erneut. Haben Sie immer noch keinen Erfolg, wenden Sie sich bitte über die Kontaktdaten auf der Rückseite dieses Handbuchs an den Technischen Service der Boston Scientific Corporation, oder kontaktieren Sie Ihren Boston Scientific-Vertreter vor Ort.

## Bluetooth®

Die Bluetooth®-Konnektivität wird zur Kommunikation mit Bluetooth®-fähigen Druckern zum Drucken von Patientendaten und Berichten sowie zur Kommunikation mit anderen Computern zur Übertragung von Patientendaten an LATITUDE Link verwendet.

Um eine unvollständige Bluetooth®-Datenübertragung wiederherzustellen, starten Sie die Übertragung erneut. Haben Sie immer noch keinen Erfolg, wenden Sie sich bitte über die Kontaktdaten auf der Rückseite dieses Handbuchs an den Technischen Service der Boston Scientific Corporation, oder kontaktieren Sie Ihren Boston Scientific-Vertreter vor Ort.

## USB

Patientendaten und Berichte können auf einem über USB angeschlossenen Drucker gedruckt oder auf einem USB-Stick gespeichert werden, um sie zum Drucken an ein anderes Gerät zu übertragen.

Um eine unvollständige USB-Datenübertragung wiederherzustellen, versuchen Sie die Übertragung neu zu starten oder verwenden Sie einen anderen USB-Stick. Haben Sie immer noch keinen Erfolg, wenden Sie sich bitte über die Kontaktdaten auf der Rückseite dieses Handbuchs an den Technischen Service der Boston Scientific Corporation, oder kontaktieren Sie Ihren Boston Scientific-Vertreter vor Ort.

## Optionale externe Geräte

Optional können externe Geräte mit dem LATITUDE-Programmiersystem verwendet werden. Wenden Sie sich bitte an den zuständigen Boston Scientific-Außendienstmitarbeiter, um zu bestimmen, welche externen Geräte verwendet werden können.

**HINWEIS:** Wenn Sie externe Geräte hinzufügen, konfigurieren Sie ein medizinisches System und tragen die Verantwortung dafür, dass das System die Anforderungen der Norm IEC/EN 60601-1, Klausel 16 für medizinische elektrische Geräte, erfüllt.



**WARNUNG: Berühren** Sie nicht gleichzeitig den Patienten und zugängliche Stecker oder freigelegte Leiter des LATITUDE-Programmiersystems.

**VORSICHT:** Es kann sein, dass optionale externe Geräte, die an das LATITUDE-Programmiersystem angeschlossen werden, die Anforderungen für im Handel erhältliche Produkte hinsichtlich Ableitströmen erfüllen, die strengeren Anforderungen für medizinische Produkte hinsichtlich Ableitströmen jedoch nicht. Daher müssen sämtliche externen Geräte außerhalb des Patientenbereichs verbleiben.

### Externer Drucker

Das LATITUDE-Programmiersystem unterstützt eine breite Palette an externen USB-Druckern. Informationen zum Anschließen des geeigneten USB 2.0- oder 3.0-Druckerkabels finden Sie in der entsprechenden Anleitung („Anschlüsse“ auf Seite 8).

**HINWEIS:** USB 3.0-Drucker können Druckdaten schneller verarbeiten als USB 2.0.

Einige Bluetooth®-Drucker werden ebenfalls unterstützt. Siehe „Bluetooth®-Konnektivität“ auf Seite 14.

### DisplayPort für einen externen Monitor

Sie können ein externes Videogerät oder einen digitalen Monitor (oder ein ähnliches Gerät) verwenden, der alle horizontalen Scanfrequenzen synchronisieren kann, um den Bildschirm des Programmiergeräts anzuzeigen.

**HINWEIS:** Für externe Monitore ist möglicherweise ein Adapter und/oder ein Kabel erforderlich, um eine Verbindung zum DisplayPort am Programmiergerät herzustellen.

**HINWEIS:** Geräte, die an die externen Anschlüsse angeschlossen sind, müssen die jeweiligen Standards erfüllen (d.h. IEC/EN 60950-1 für Geräte zur Datenverarbeitung und IEC/EN 60601-1 für medizinische Geräte).




**WARNUNG:** Die Verwendung von Kabeln oder Zubehöerteilen mit dem LATITUDE-Programmiersystem, die nicht von Boston Scientific mitgeliefert oder angegeben werden, könnte zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen, verringerter elektromagnetischer Störsicherheit oder elektrischem Schock beim LATITUDE-Programmiersystem führen. Jede Person, die derartige Kabel oder Zubehöerteile an das LATITUDE Programmiersystem anschließt (dies gilt auch für die Verwendung von Mehrfachsteckdosen), konfiguriert damit ein medizinisches System und trägt die Verantwortung dafür, dass dieses System die Anforderungen der Norm IEC/EN 60601-1, Klausel 16 für medizinische elektrische Geräte erfüllt.

## ANSCHLÜSSE

Informationen zum Identifizieren der Netzwerk- und Konnektivitätsanschlüsse am Programmiergerät Modell 3300 finden Sie in Abbildung 2.

### Seitliches Bedienfeld für Ärzte (linke Seite)

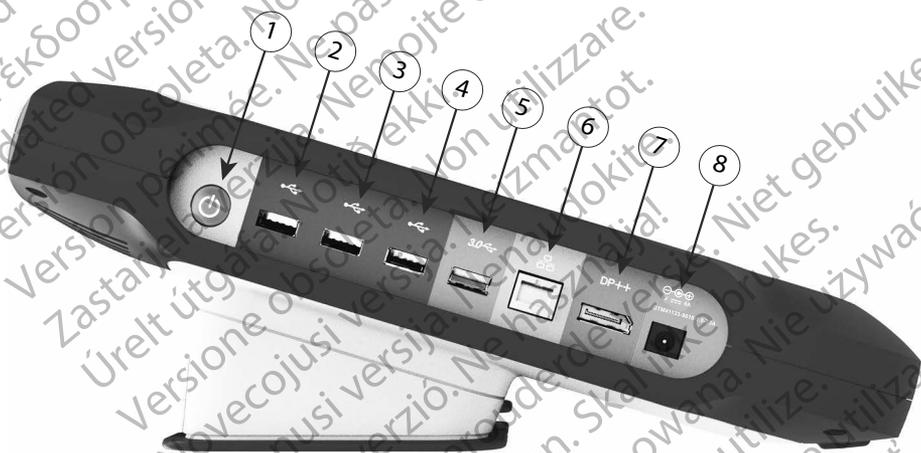

- [1] Netzschalter (EIN/AUS) [2] USB 2.0-Anschluss [3] USB 2.0-Anschluss  
[4] USB 2.0-Anschluss [5] USB 3.0-Anschluss [6] Ethernet-Anschluss [7] DisplayPort-Anschluss [8] Gleichstromanschluss (für Netzadapter Modell 6689)

**Abbildung 2. Bildschirm an der linken Seite des LATITUDE-Programmiersystems**

# VERWENDEN VON NETZWERK- UND KONNEKTIVITÄTSFUNKTIONEN

## Kabelanschlüsse für Netzwerk und Konnektivität

Nehmen Sie nach Bedarf die folgenden Anschlüsse auf der linken Seite des LATITUDE-Programmiersystems vor.



**WARNUNG:** Die Verwendung von Kabeln oder Zubehörteilen mit dem LATITUDE-Programmiersystem, die nicht von Boston Scientific mitgeliefert oder angegeben werden, könnte zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen, verringerter elektromagnetischer Störsicherheit oder elektrischem Schock beim LATITUDE-Programmiersystem führen. Jede Person, die derartige Kabel oder Zubehörteile an das LATITUDE Programmiersystem anschließt (dies gilt auch für die Verwendung von Mehrfachsteckdosen), konfiguriert damit ein medizinisches System und trägt die Verantwortung dafür, dass dieses System die Anforderungen der Norm IEC/EN 60601-1, Klausel 16 für medizinische elektrische Geräte erfüllt.

1. **Ethernet:** Wenn Sie eine Verbindung zu einem lokalen Netzwerk (LAN) herstellen möchten, schließen Sie ein Ethernet-Kabel nur an den Ethernet-Anschluss an.

**HINWEIS:** Bei der Verwendung von Bluetooth®- oder LAN-Kommunikationen müssen weitere Schritte ausgeführt werden. Siehe „Ethernet-Konnektivität“ auf Seite 17 und „Bluetooth®-Konnektivität“ auf Seite 14.

2. **Externer Monitor:** Wenn Sie einen externen Monitore anschließen möchten, verbinden Sie das digitale Displaykabel mit dem Ausgangsanschluss des DisplayPort. Stellen Sie sicher, dass der Monitor an eine externe Stromquelle angeschlossen ist. Bei einigen Monitoren muss der DisplayPort-Anschluss für eine korrekte Anzeige entfernt und wieder angeschlossen werden, um das Video neu zu synchronisieren.

3. **USB-Drucker:** Um einen externen USB-Drucker anzuschließen, verbinden Sie das korrekte USB-Kabel mit dem entsprechenden USB-Anschluss am Programmiergerät Modell 3300. Stellen Sie dann sicher, dass der Drucker an eine externe Stromquelle angeschlossen ist.

**HINWEIS:** Das LATITUDE-Programmiersystem verfügt über Bluetooth®-Funktionen, die verwendet werden können, um eine Verbindung zu Bluetooth®-fähigen Druckern herzustellen. Siehe die „Bluetooth®-Konnektivität“ auf Seite 14.


---

a. Für einige Display-Kabel ist möglicherweise ein DisplayPort-Adapter Kabel erforderlich, um eine Verbindung zum DisplayPort herzustellen.

# Einrichten von Netzwerken und Konnektivität

Wenn das LATITUDE-Programmiersystem eingeschaltet wird, warten Sie, bis der Hauptbildschirm angezeigt wird. Dies dauert bis zu eine Minute. Der Hauptbildschirm wird angezeigt, wie in Abbildung 3 dargestellt:

Am unteren Bildschirmrand befindet sich die Taste Dienstprogramme, welche den Zugriff auf Informationen zum LATITUDE-Programmiersystem und auf Einstellungsfunktionen einschließlich der Netzwerkeinrichtung ermöglicht.

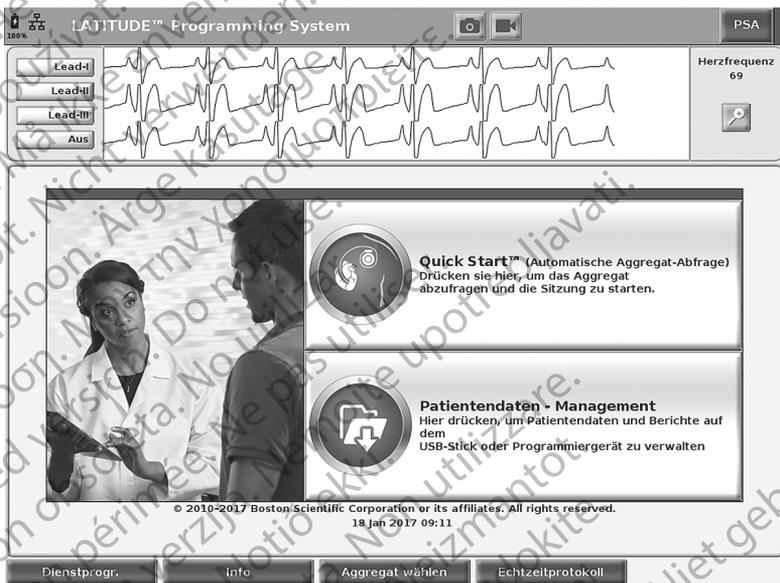

[1] Die Taste Dienstprogramme

Abbildung 3. Hauptbildschirm

## Die Taste „Dienstprogramme“

Vor der Geräteabfrage verwenden Sie die Taste Dienstprogramme, um Netzwerk- und Konnektivitätsfunktionen zu konfigurieren.

Durch Klicken auf die Taste Dienstprogrammes werden die Optionen der Registerkarte Dienstprogramme angezeigt. Auf der Registerkarte Einrichten des Netzwerks werden Registerkarten Wireless, Bluetooth® und Ethernet & Proxy angezeigt, wie in Abbildung 4 dargestellt.

Weitere Funktionen zum Einrichten, Datum und Uhrzeit und Softwareaktualisierung finden Sie in der *Gebrauchsanweisung zum LATITUDE-Programmiersystem Modell 3300*.



**Abbildung 4. Dienstprogramme – Einrichten des Netzwerks**

## Registerkarte „Einrichten des Netzwerks“ – Übersicht

Die Registerkarte Einrichten des Netzwerks bietet Konnektivität zu Netzwerken und Geräten über Wi-Fi, Bluetooth® und Ethernet-Netzwerkprotokolle. Informationen zum Verbindungsanschluss für Ethernet-Netzwerke am Programmiergerät Modell 3300 finden Sie in Abbildung 2 auf Seite 8.

- Über die Einrichtung von **Wireless** kann eine Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken mit öffentlichen/nicht gesicherten, WPA-PSK- und WPA2-PSK-Netzwerken hergestellt werden (siehe „Wireless(Wi-Fi)-Konnektivität“ auf Seite 11).
- Bei der **Bluetooth®**-Einrichtung wird eine Verbindung zu einem anderen Gerät wie einem externen Drucker oder Computer hergestellt (siehe „Bluetooth®-Konnektivität“ auf Seite 14).
- Bei der **Ethernet & Proxy**-Einrichtung wird eine Verbindung zu einem lokalen Netzwerk hergestellt (siehe „Ethernet-Konnektivität“ auf Seite 17).

**HINWEIS:** *Wenden Sie sich an den IT- oder IS-Systemkoordinator vor Ort, wenn Sie besondere Konfigurationsanforderungen haben. Weitere Informationen erhalten Sie beim Technischen Service der Boston Scientific Corporation. Verwenden Sie hierzu die Kontaktdaten auf der Rückseite dieses Handbuchs.*

## Wireless(Wi-Fi)-Konnektivität

Die Wireless-Konnektivität bietet die folgenden Funktionen:

- Wi-Fi unterstützt nur dynamische IP-Adressierung (Wi-Fi-Spezifikationen finden Sie in Tabelle 1 auf Seite 21).

- Wi-Fi-Nutzer können Verbindungen zu öffentlichen/nicht gesicherten, WPA-PSK- und WPA2-PSK-Netzwerken herstellen.
- Die Wi-Fi-Konnektivität wird über die Taste „Wi-Fi aktivieren“ aktiviert und deaktiviert (siehe Abbildung 4 auf Seite 11).
- Die Spalten können nach Name, Signalstärke, Sicherheit und Status sortiert werden. Die Liste mit aktiven Wi-Fi-Netzwerken wird alle 30 Sekunden aktiviert, während sie auf diesem Bildschirm angezeigt wird.
- Benutzer können über den Bildschirm Wi-Fi-Details eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen. Dieser Bildschirm kann durch Auswählen der Vergrößerungstaste links vom Wi-Fi-Namen geöffnet werden.
  - Über die Option „Aliasname“ auf dem Bildschirm Wi-Fi-Details können Benutzer den Netzwerken aussagekräftigere Namen geben (siehe Abbildung 8 auf Seite 14).
  - Die Benutzer können das System so konfigurieren, dass es automatisch (oder manuell) eine Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken in Reichweite herstellt.
  - Es können bis zu 5 Wi-Fi-Netzwerke auf dem Programmiergerät Modell 3300 gespeichert werden. Nach der erstmaligen Verbindung wird automatisch eine Verbindung zu diesen Netzwerken hergestellt. Wenn weitere Netzwerke zu diesen fünf Netzwerken hinzugefügt werden, werden frühere Einträge ersetzt.

**HINWEIS:** Wenn der Benutzer eine Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk herstellt, während eine Wireless(Wi-Fi)-Verbindung einen Download-/Upload-Vorgang ausführt, wird dieser Download-/Upload-Vorgang gestoppt und diese Aktivität muss neu gestartet werden. Eine Informationsmeldung wird angezeigt, die besagt, dass in der Anwendung ein Fehler aufgetreten ist. Trennen Sie das Ethernet-Kabel ab, und versuchen Sie die Wireless-Übertragung erneut.

**HINWEIS:** Die Wi-Fi-Konnektivität ist in Indonesien aufgrund von spezifischen Konfigurationsanforderungen in Indonesien nicht zulässig.

### **Wireless(Wi-Fi)-Setup**


Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Wi-Fi-Kommunikation einzurichten:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wi-Fi aktivieren, um nach Netzwerken zu suchen (Abbildung 5).

**HINWEIS:** Wenn Wi-Fi einmal eingeschaltet ist, bleibt es aktiv. Zur Deaktivierung der Wi-Fi-Konnektivität klicken Sie auf die Schaltfläche Wi-Fi aktivieren, um das Kontrollkästchen zu entfernen.

2. Das Programmiergerät sucht nach allen verfügbaren Netzwerken (Abbildung 6).

3. Klicken Sie auf die Vergrößern-Schaltfläche  neben dem gewünschten Netzwerknamen, um ihn auszuwählen (Abbildung 7).
4. Geben Sie das angeforderte Wi-Fi-Passwort und optional einen Aliasnamen ein (Abbildung 8).
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Automatisch diesem Netzwerk beitreten“, um eine Verbindung zu diesem Netzwerk herzustellen, wenn es in Reichweite ist (Abbildung 8).
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche SPEICHERN, und schließen Sie dann das Fenster Wi-Fi-Details (Abbildung 8).

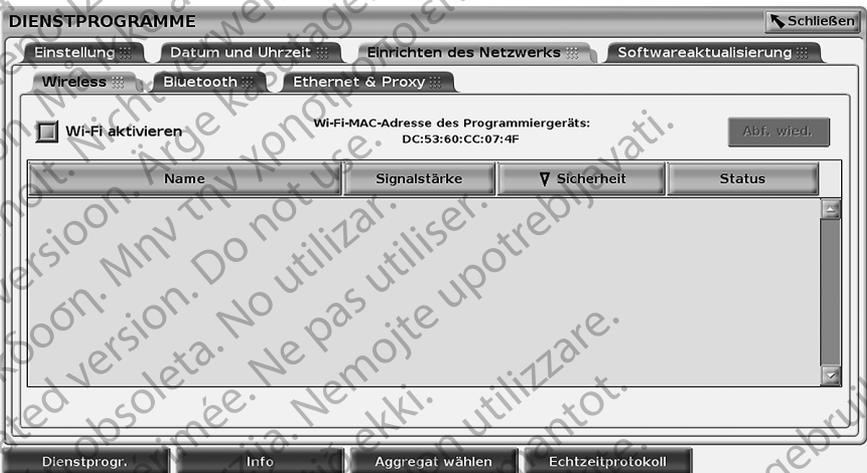

**Abbildung 5. Dienstprogramme – Einrichten des Netzwerks – Wireless Aktivieren**



**Abbildung 6. Dienstprogramme – Einrichten des Netzwerks – Wireless – Netzwerksuche**



Abbildung 7. Dienstprogramme – Einrichten des Netzwerks – Wireless – Netzwerkanzeige

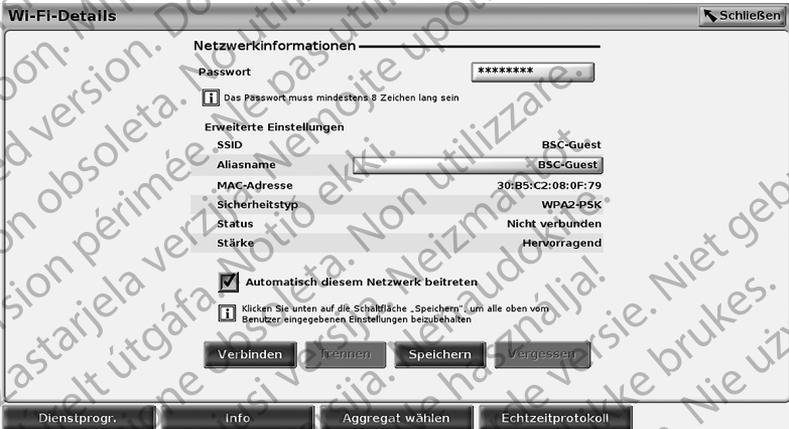


Abbildung 8. Dienstprogramme – Einrichten des Netzwerks – Wireless – Details

## Bluetooth®-Konnektivität

Die Bluetooth®-Konnektivität wird zur Kommunikation mit Bluetooth®-fähigen Druckern sowie zur Kommunikation mit anderen Computern zur Übertragung von Patientendaten an LATITUDE Link verwendet.

**HINWEIS:** Tablets, oder Telefone und andere mobile Geräte werden bei der Bluetooth®-Konnektivität mit dem LATITUDE-Programmiersystem nicht unterstützt.

Nach der Autorisierung bleibt die Bluetooth®-Verbindung aktiv. Das Programmiergerät merkt sich die Verbindung und zukünftige Verbindungen zum Gerät (Bluetooth®-fähiger PC, Laptop oder Drucker) werden automatisch hergestellt.

## Einrichtung eines Bluetooth®-fähigen PCs

So aktivieren Sie Bluetooth®-Kommunikationen und stellen Verbindungen zu Bluetooth®-fähigen PCs her:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bluetooth® aktivieren auf dem Bluetooth®-Bildschirm (siehe Abbildung 10), um eine Suche nach Bluetooth®-fähigen PCs in Reichweite zu starten (ca. 100 m [328 Fuß]).
2. Wenn die Suche abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche zum Hinzufügen , um einen Bluetooth®-fähigen Computer in der Nähe zu autorisieren und in die Liste „Autorisierte Computer“ zu verschieben. Autorisierte Computer können für Datenübertragungen verwendet werden und erscheinen als Zielloptionen auf Datenübertragungsbildschirmen angezeigt.
3. Falls dies die erstmalige Verbindung mit dem Bluetooth®-PC ist, geben Sie entweder den Verbindungscode für das Gerät ein, oder bestätigen Sie den vom PC übermittelten Verbindungscode.



Abbildung 9. Dienstprogramme – Einrichten des Netzwerks - Bluetooth®-Verbindungscode-Optionen

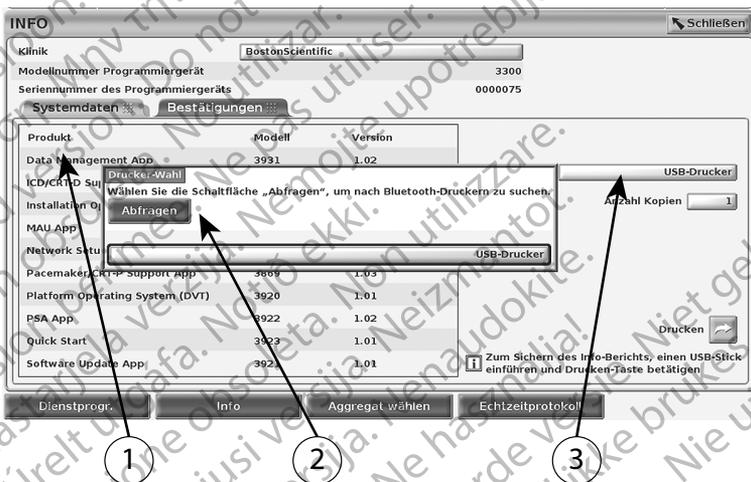


Abbildung 10. Dienstprogramme – Einrichten des Netzwerks - Bluetooth®-Computer

## Bluetooth®-Druckereinstellung


Um eine Verbindung zu Bluetooth®-Druckern herzustellen, beachten Sie Abbildung 11, und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche Bluetooth aktivieren® auf der Registerkarte Bluetooth® aktiviert ist (Informationen finden Sie unter Abbildung 10 auf Seite 15).
2. Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Info.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Systemdaten.
4. Klicken Sie auf die Auswahlstaste USB-Drucker, und klicken Sie dann im Popup-Fenster auf die Schaltfläche Scan.
5. Wenn die Suche abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche zum Hinzufügen  neben dem gewünschten Drucker in der Liste Nicht autorisierte Drucker in der Nähe, um ihn zur Liste Autorisierte Drucker hinzuzufügen. Siehe Abbildung 12 auf Seite 17.



[1] Registerkarte „Systemdaten“; [2] Schaltfläche „Scan“; [3] Auswahlleiste für USB-Drucker

Abbildung 11. Bluetooth®-Druckereinstellung

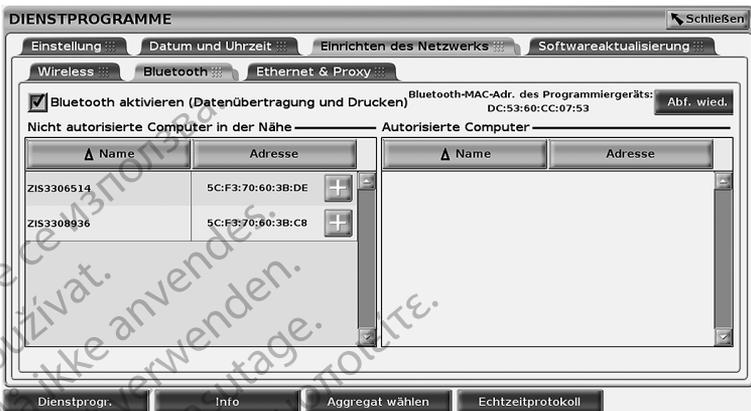

**Abbildung 12. Ergebnisse der Suche nach Bluetooth®-Druckern**

**HINWEIS:** Der Benutzer kann Drucker auch in transvenösen PG-Anwendungen über die Druckerauswahloption hinzufügen und konfigurieren.

**HINWEIS:** Wenn mehr als ein Drucker in der Liste autorisierter Drucker angezeigt wird, den gewünschten Drucker auswählen. Der Drucker bleibt ausgewählt, bis im Bildschirm Bluetooth-Drucker ein anderer Drucker aus der autorisierten Liste ausgewählt wird.

**HINWEIS:** Die Druckernamen können nicht bearbeitet oder geändert werden.

Wenn Bluetooth® aktiviert ist und auf einem Bildschirm Druckfunktionen angezeigt werden, wird der ausgewählte Drucker verwendet.

## Ethernet-Konnektivität

Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, und sehen Sie in Tabelle 1 auf Seite 21 nach, um die erforderlichen Einstellungen für die Verbindung zu Ihrem Ethernet-Netzwerk zu ermitteln. Die Ethernet-Verbindung kann so eingestellt werden, dass automatisch eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt wird, wenn das Ethernet-Kabel eingesteckt wird. Es kann immer nur eine Ethernet-Verbindung definiert werden.

Wenn Sie die Funktion Auto Connect verwenden möchten, aktivieren Sie die Option Automatisch verbinden, und drücken Sie dann die Taste Verbinden. Wird die Taste Verbinden nicht gedrückt, wird die automatische Verbindung nicht aktiviert.


**HINWEIS:** Verbinden Sie das Ethernet-Kabel nur mit dem RJ45-Ethernet-Port-Anschluss auf dem Programmiergerät Modell 3300.

**HINWEIS:** Bei dem Ethernet-Anschluss auf dem Programmiergerät Modell 3300 handelt es sich um eine RJ-45-Verbindung. Verbinden Sie keinen Telefonstecker mit diesem Anschluss. Informationen zum Ethernet-Verbindungsanschluss auf dem Programmiergerät Modell 3300 finden Sie in „Abbildung 2. Bildschirm an der linken Seite des LATITUDE-Programmiersystems“ auf Seite 8.

**HINWEIS:** Wenn eine Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk besteht, wird die integrierte Uhr vom Netzwerk gestellt. Wird eine Ethernet-Verbindung nicht verwendet, kann die integrierte Uhr bis zu 12 Minuten pro Jahr abweichen und müsste dann manuell zurückgesetzt werden. Wenn die integrierte Uhr korrigiert werden muss, wenden Sie sich an den Technischen Service von Boston Scientific. Verwenden Sie hierzu die Kontaktdaten auf der Rückseite dieses Handbuchs.

Abbildung 13 zeigt den Bildschirm zur Einrichtung von Ethernet & Proxy mit eingerichteter Option Automatisch verbinden und Abbildung 14 zeigt die erforderlichen Parameter zur Verwendung eines Proxy-Server.

Klicken Sie für Proxy-Einstellungen auf die Schaltfläche „Proxy-Server verwenden“ (Abbildung 13), und geben Sie dann die Proxy-Informationen an, wie in Abbildung 14 dargestellt.

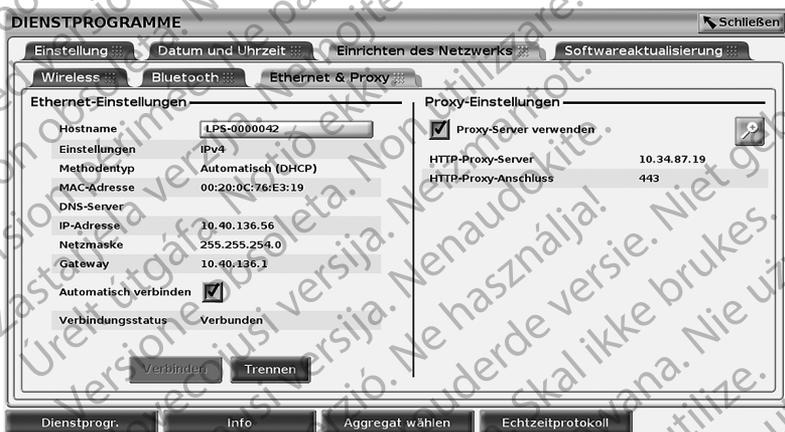

**Abbildung 13. Dienstprogramme – Einrichten des Netzwerks – Ethernet & Proxy**



**Abbildung 14. Dienstprogramme – Einrichten des Netzwerks – Proxy-Einstellungen**

## WARTUNG

Wenden Sie sich bei Fragen bezüglich des Betriebs oder der Reparatur des LATITUDE-Programmiersystems über die Kontaktinformationen auf der Rückseite dieses Handbuchs an Boston Scientific. Das LATITUDE-Programmiersystem darf nur von Mitarbeitern von Boston Scientific gewartet werden.

Wenn das LATITUDE-Programmiersystem nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie, ob das Netzkabel und die anderen Kabel richtig angeschlossen und in einwandfreiem Zustand (d. h. frei von sichtbaren Schäden) sind. Bei Problemen mit dem externen Display oder Drucker sehen Sie bitte in der Gebrauchsanweisung für das jeweilige Gerät nach.

## SICHERHEIT DES PROGRAMMIERSYSTEMS

Es sind sensible Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, um die Integrität der Patientendaten und des Programmiersystems im Netzwerk zu schützen. Das Programmiergerät Modell 3300 umfasst Funktionen zur Vereinfachung der Verwaltung der Netzwerksicherheit. Diese Funktionen sorgen zusammen mit den Sicherheitsmaßnahmen der Krankenhäuser und Kliniken für einen sicheren und geschützten Betrieb des Programmiergeräts Modell 3300 und schützt das angeschlossene Netzwerk.

**HINWEIS:** *Alle Patientendaten auf der Festplatte des Programmiergeräts Modell 3300 sind verschlüsselt, und das Programmiergerät verfügt über Netzwerk-Sicherheitsvorkehrungen, um böswillige Angriffe zu verhindern.*

Verbindung des Programmiergeräts Modell 3300 mit dem Netzwerk, das zusätzliche Geräte umfasst, könnte zu zuvor nicht identifizierten Risiken führen. Der Netzwerkadministrator des Krankenhauses und/oder er Klinik sollte diese Risiken identifizieren, analysieren, bewerten und kontrollieren.

## Netzwerksicherheit

Das Programmiergerät Modell 3300 wurde auf eine Weise entwickelt und getestet, welche die Kommunikation in einem Netzwerk einschränkt. Bei einer Kommunikation über ein Netzwerk verwendet das Programmiergerät branchenweit akzeptierte Protokolle zur Authentifizierung von Servern und Verschlüsselung übertragener Daten. Nur die erforderlichen Netzwerkverbindungen sind offen. Die Netzwerk Kommunikationen werden vom Programmiergerät gestartet.

Nicht autorisierter Software ist es nicht erlaubt, Kommunikationen mit dem Programmiergerät zu starten. Verbinden Sie das Programmiergerät nur mit verwalteten, sicheren Netzwerken. Das Programmiergerät verfügt über Netzwerk-Sicherheitsvorkehrungen zur Verhinderung bösartiger Angriffe.

## Physikalische Kontrollen

Treffen Sie angemessene physikalische Kontrollmaßnahmen für das Programmiergerät Modell 3300. Eine sichere physikalische Umgebung verhindert den Zugriff auf interne Komponenten des Programmiergeräts. An das Programmiergerät angeschlossene USB-Geräte sollten kontrolliert werden, um die Infizierung von Schadsoftware zu begrenzen. Sensible Patientendaten können auf der internen Festplatte gespeichert werden, und es sollten geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um das Programmiergerät vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

## Beeinträchtigtes Programmiergerät Modell 3300

Wenn Sie glauben, dass das Programmiergerät-Modell 3300 durch eine Sicherheitsbedrohung beeinträchtigt wurde, schalten Sie das Programmiergerät aus, trennen Sie es vom Netzwerk, und starten Sie es neu. Wenn der Selbsttest beim Start des Programmiergeräts Modell 3300 fehlschlägt oder das Gerät nicht arbeitet wie erwartet, verwenden Sie es nicht weiter. Wenden Sie sich bitte über die Kontaktdaten auf der Rückseite dieses Handbuchs an den Technischen Service der Boston Scientific Corporation, oder kontaktieren Sie Ihren Boston Scientific-Vertreter vor Ort, um weitere Unterstützung zu erhalten.

**HINWEIS:** Das LATITUDE-Programmiersystem muss für den sicheren Betrieb nicht mit einem Netzwerk verbunden sein.

# SPEZIFIKATIONEN

**Tabelle 1. Netzwerk und Konnektivität – Merkmale und Konfiguration**

Merkmale	Spezifikation
Erforderliche Merkmale des IT-Netzwerks	
Ethernet	IEEE 802.3u, 100 Mbit/s voll duplex und halbduplex auf 100BASE-TX IEEE 802.3ab, 1 Gbit/s voll duplex und halbduplex auf 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11g, 802.11n und 802.11ac
Gefährliche Situationen aufgrund eines Netzwerkausfalls	Keine
Erforderliche Konfiguration des IT-Netzwerks	
Ethernet	Dynamische oder statische IP-Adressierung
Wi-Fi	Dynamische IP-Adressierung unter Verwendung der Spezifikationen von IEEE 802.11g, 802.11n oder 802.11ac zum Verbinden mit Netzwerken, die öffentlich/ungesichert sind, WPA-PSK oder WPA2-PSK
Ethernet MAC-Adresse	Die Netzwerk-MAC-Adresse kann angezeigt werden und der Hostname ist editierbar (siehe Abbildung 13 auf Seite 18)
Internetprotokoll	IPv4
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Modus	Es werden sowohl manuelle als auch automatische DHCP-Modi unterstützt.
Wi-Fi MAC-Adresse	Kann angezeigt werden (siehe Abbildung 7 auf Seite 14)

## GARANTIE

Informationen zur Garantie finden Sie in der *Gebrauchsanweisung für das LATITUDE-Programmiersystem, Modell 3300*.

рсия. Да не се използва.  
erze. Ne používat.  
version. Må ikke anvendes.  
n überholt. Nicht verwenden.  
unud version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úrelt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Elavult verzió. Ne használja!

Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Versione expirată. A nu se utiliza.

Zastaraná verzia. Nepoužívať.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd  
ancel olmayan sürüm. K

рсия. Да не се използва.  
erze. Nepoužívajte.  
version. Må ikke anvendes.  
n überholt. Nicht verwenden.  
n version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreлт útгáфа. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.  
Zastarana verzija. Nepoužívajte.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd  
ancel olmayan sürüm. K

# Boston Scientific



Boston Scientific Corporation  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Manufactured at: Plexus Corporation  
2400 Millbrook Drive  
Buffalo Grove, IL 60089 USA



Europe NV/SA, Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium



Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
Botany NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 666

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

IC: 4794A-CRM33007 (Enthält IC:1000M-7265NG)



**CE0086**

Authorized 2017

© 2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All Rights Reserved.

360166-021 DE Europe 2017-07

