

TECHNICKÁ PRÍRUČKA MR



ImageReady™ MR

Conditional Defibrillation System

REF D000, D001, D002, D003, D010, D011, D012, D013, D020, D021, D022, D023, D044, D045, D046, D047, D050, D051, D052, D053, D120, D121, D140, D141, D142, D143, D150, D151, D152, D153, D174, D175, D176, D177, D220, D221, D232, D233, D320, D321, D332, D333, D400, D401, D412, D413, D420, D421, D432, D433, D500, D501, D512, D513, D520, D521, D532, D533, G050, G051, G056, G058, G124, G125, G128, G138, G140, G141, G146, G148, G150, G151, G156, G158, G172, G173, G177, G179, G224, G225, G228, G237, G247, G248, G324, G325, G328, G337, G347, G348, G424, G425, G428, G437, G447, G448, G524, G525, G528, G537, G547, G548, 0127, 0128, 0129, 0137, 0138, 0139, 0143, 0147, 0148, 0149, 0153, 0157, 0158, 0159, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0262, 0263, 0265, 0266, 0272, 0273, 0275, 0276, 0282, 0283, 0285, 0286, 0292, 0293, 0295, 0296, 0636, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0657, 0658, 0662, 0663, 0665, 0672, 0673, 0675, 0676, 0682, 0683, 0685, 0686, 0692, 0693, 0695, 0696, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4479, 4480, 4542, 4543, 4544, 4591, 4592, 4593, 4603, 4671, 4672, 4674, 4675, 4677, 4678, 6100, 6220, 6221, 6402, 6403, 6773, 6996, 7145, 7148, 7735, 7736, 7740, 7741, 7742

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Myn þyn Χρησιμοποιείτε.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Novecojsi versija. Non utilizzare.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

INFORMÁCIE O TEJTO PRÍRUČKE

Tento manuál je určený pre lekárov a iných odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorí sa zaoberajú starostlivosťou o pacientov s defibrilačným systémom ImageReady podmienične kompatibilným s prostredím MR, ako aj pre rádiológov a iných odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorí sa u takýchto pacientov zaoberajú zobrazovaním magnetickou rezonanciou (MR).

POZNÁMKA: V tejto technickej príručke sa výraz MR používa ako všeobecný termín a zahŕňa všetky činnosti klinického zobrazovania založené na magnetickej rezonancii. Okrem toho informácie v tejto príručke sa vzťahujú len na snímače MR typu hydrogen proton.

Pred vyšetrením pacientov s implantovaným defibrilačným systémom ImageReady podmienične kompatibilným s prostredím MR si prečítajte celý tento manuál.

Tento manuál obsahuje:

- Informácie o defibrilačnom systéme ImageReady podmienične kompatibilnom s prostredím MR (transvenózne ICD a CRT-D Boston Scientific)
- Informácie o tom, ktorí pacienti s defibrilačným systémom ImageReady podmienične kompatibilným s prostredím MR môžu a ktorí nemôžu podstúpiť vyšetrenie na systéme MR, a podmienky používania, ktoré je potrebné dodržať, aby bolo možné vykonať vyšetrenie na systéme MR
- Pokyny na vykonanie vyšetrenia MR u pacientov s defibrilačným systémom ImageReady podmienične kompatibilným s prostredím MR

Práca s touto príručkou:

1. Pozrite si záznamy o pacientovi, aby ste vyhľadali čísla modelov všetkých súčastí systému, ktorý má pacient implantovaný.
2. Pozrite si časť "Systémová konfigurácia pre intenzitu 1,5 tesla (T) a 3 tesla (T)" na strane 1-2, aby ste stanovili, či sa všetky súčasti systému, ktorý ma pacient implantovaný, nachádzajú v tabuľkách. Ak v týchto tabuľkách nenájdete ktorúkoľvek zo súčiastok, nejedná sa o defibrilačný systém ImageReady podmienične kompatibilný s prostredím MR.

POZNÁMKA: K dispozícii sú viaceré technické príručky k používaniu systému Boston Scientific ImageReady v prostredí MR na základe typu terapie, napríklad na základe toho, či sa jedná o stimulačný systém alebo defibrilačný systém. Ak nie je určitý generátor impulzov v tejto príručke opísaný, pozrite si tú inú technickú príručku pre použitie systému ImageReady spoločnosti Boston Scientific v prostredí MR. Ak sa určitý model neopisuje v žiadnej technickej príručke k používaniu systému Boston Scientific ImageReady v prostredí MR, systém implantovaný pacientovi nie je systémom ImageReady podmienične kompatibilným s prostredím MR.

Podrobné informácie o aspektoch implantácie, ktoré nesúvisia s magnetickou rezonanciou, o funkciách, programovaní a používaní súčastí defibrilačného systému nájdete v Technickom manuáli pre lekára, Referenčnej príručke, Manuáli k elektróde, Príručke pre lekárov alebo Návode na obsluhu pre programátora.

POZNÁMKA: V závislosti od softvéru a regionálnej dostupnosti je k dispozícii viacero programovacích systémov, ktoré zahŕňajú rôzne programovacie zariadenia, napríklad programátor/nahrávacie zariadenie/monitor (PRM), model 3120 a programátor, model 3300. V tejto príručke sa ako programátor označuje príslušné programovacie zariadenie prepojené s programovacím systémom, ktoré je k dispozícii pre pacienta. Podrobnosti nájdete v príslušnej technickej príručke pre lekárov a v návode na obsluhu.

Nižšie sú uvedené ochranné známky spoločnosti Boston Scientific Corporation alebo jej pridružených spoločností:

ACUITY, AUTOGEN, CHARISMA, DYNAGEN, EASYTRAK, ENDOTAK RELIANCE, FINELINE, IMAGEREADY, INGEVITY, INOGEN, LATITUDE, MOMENTUM, ORIGEN, PaceSafe, PERCIVA, RELIANCE 4-FRONT, RESONATE, VIGILANT.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantoj.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

OBSAH

ÚVOD DO DEFIBRILAČNÉHO SYSTÉMU PODMIENEČNE KOMPATIBILNÉHO S PROSTREDÍM MR.....	1-1
KAPITOLA 1	
Opis systému.....	1-2
Systémová konfigurácia pre intenzitu 1,5 tesla (T) a 3 tesla (T).....	1-2
Podmienky použitia systému MR.....	1-6
Kardiológia.....	1-6
Rádiológia.....	1-7
MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).....	1-9
Základné charakteristiky MR.....	1-9
Varovania a preventívne opatrenia pre defibrilačný systém podmiennečne kompatibilný s prostredím MR.....	1-10
Všeobecné.....	1-10
Dôležité informácie o programovaní.....	1-11
Bezpečnostný režim.....	1-11
Vylúčenia zo zóny III prostredia MR.....	1-12
Preventívne opatrenia.....	1-12
Možné nežiaduce účinky.....	1-12
POSTUP SKENOVACIEHO VYŠETRENIA MR.....	2-1
KAPITOLA 2	
Priebeh patientskeho prípadu.....	2-2
Všeobecné informácie o režime ochrany pri MR.....	2-3
Činnosti predchádzajúce vyšetreniu.....	2-4
Naprogramovanie generátora impulzov na vyšetrenie.....	2-4
Potvrdenie nastavení a konfigurácie systému MR.....	2-12
Príprava pacienta na vyšetrenie.....	2-12
Po vyšetrení.....	2-13
KONTROLNÝ KARDIOLOGICKÝ ZOZNAM DEFIBRILAČNÉHO SYSTÉMU IMAGEREADY.....	A-1
PRÍLOHA A	
KONTROLNÝ RÁDIOLOGICKÝ ZOZNAM DEFIBRILAČNÉHO SYSTÉMU IMAGEREADY.....	B-1
PRÍLOHA B	
SÚČASTI DEFIBRILAČNÉHO SYSTÉMU IMAGEREADY PRE INTENZITY 1,5 T A 3 T.....	C-1
PRÍLOHA C	
SPRÁVY PROGRAMÁTORA DEFIBRILÁTORA PODMIENEČNE KOMPATIBILNÉHO S PROSTREDÍM MR.....	D-1
PRÍLOHA D	
SYMBOLY NA BALENÍ.....	E-1
PRÍLOHA E	

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Myn την χρησιμοποιείτε.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Novcojusi versija. Non utilizzare.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

ÚVOD DO DEFIBRILAČNÉHO SYSTÉMU PODMIENEČNE KOMPATIBILNÉHO S PROSTREDÍM MR

KAPITOLA 1

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

- “Opis systému” na strane 1-2
- “Podmienky použitia systému MR” na strane 1-6
- “MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR)” na strane 1-9
- “Základné charakteristiky MR” na strane 1-9
- “Varovania a preventívne opatrenia pre defibrilačný systém podmiennečne kompatibilný s prostredím MR” na strane 1-10
- “Možné nežiaduce účinky” na strane 1-12

OPIS SYSTÉMU

Defibrilačný systém ImageReady podmiennečne kompatibilný s prostredím MR pozostáva zo špecifických súčastí modelov Boston Scientific zahŕňajúcich generátory impulzov, elektródy, príslušenstvo, programátor a softvérovú aplikáciu programátora. Možno zobrazovať ktorúkoľvek časť tela. Spoločné použitie generátorov impulzov a elektród od spoločnosti Boston Scientific podmiennečne kompatibilných s prostredím MR znižuje riziko spojené so skenovacím vyšetrením MR v porovnaní s klasickými generátormi impulzov a elektródami. Implantovaný systém, na rozdiel od svojich zložiek, má status zariadenia podmiennečne kompatibilného s prostredím MR podľa normy ASTM F2503:2008. Predtým ako pacient podstúpi vyšetrenie pomocou MR, treba defibrilačný systém ImageReady naprogramovať na režim MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Režim MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) upravuje správanie generátora impulzov a prispôsobuje ho elektromagnetickému prostrediu vyšetrenia na systéme MR ("Všeobecné informácie o režime ochrany pri MR" na strane 2-3). Možno naprogramovať funkciu časového intervalu vypnutia, ktorá umožní automatické ukončenie režimu MRI Protection (Režim ochrany pri MR) po používatelom nastavenom počte hodín. Účinnosť dizajnu sa overovala hodnotením ich účinnosti. Iné riziká spojené s MR sa ďalej znižujú, ak sa dodržia podmienky vyšetrenia uvedené v tejto technickej príručke.

Iba špecifické kombinácie generátorov impulzov a elektród tvoria defibrilačný systém ImageReady. Schválené kombinácie, ktoré je možné použiť so skenermi s intenzitami magnetického poľa 1,5 T alebo 3 T, nájdete v nasledujúcich tabuľkách. Čísla modelov súčastí defibrilačného systému podmiennečne kompatibilného s prostredím MR nájdete v časti "Systémová konfigurácia pre intenzitu 1,5 tesla (T) a 3 tesla (T)" na strane 1-2.

Doplňujúce informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Boston Scientific na adrese <http://www.bostonscientific.com/imageready>.

Ostatné technické referenčné príručky nájdete na adrese www.bostonscientific-elabeling.com.

Systémová konfigurácia pre intenzitu 1,5 tesla (T) a 3 tesla (T)

Šedé tieňovanie v riadkoch modelov označuje súčasti kompatibilné s obomi snímačmi s intenzitou 1,5 T a 3 T. Znak x označuje stav Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR pri uvedenej intenzite magnetického poľa.

Tabuľka 1-1. Generátory impulzov CRT-D – defibrilačný systém ImageReady podmiennečne kompatibilný s prostredím MR

Súčasť	Čísla modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
Generátory impulzov CRT-D				
AUTOGEN X4 CRT-D	G177, G179	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
AUTOGEN CRT-D	G172, G173	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
CHARISMA X4 CRT-D	G328, G348	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	G337, G347	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
CHARISMA CRT-D	G324, G325	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
DYNAGEN X4 CRT-D	G156, G158	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	

Tabuľka 1–1. Generátory impulzov CRT-D – defibrilačný systém ImageReady podmienne kompatibilný s prostredím MR (pokračovanie)

Súčasť	Čísla modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
DYNAGEN CRT-D	G150, G151	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
INOGEN X4 CRT-D	G146, G148	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
INOGEN CRT-D	G140, G141	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
MOMENTUM CRT-D X4	G128, G138	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
MOMENTUM CRT-D	G124, G125	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
ORIGEN X4 CRT-D	G056, G058	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
ORIGEN CRT-D	G050, G051	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
RESONATE HF CRT-D	G524, G525, G528, G548	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
	G537, G547	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	X
RESONATE X4 CRT-D	G428, G448	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
	G437, G447	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	X
RESONATE CRT-D	G424, G425	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
VIGILANT X4 CRT-D	G228, G248	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
	G237, G247	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	X
VIGILANT CRT-D	G224, G225	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	

Tabuľka 1–2. Generátory impulzov ICD – defibrilačný systém ImageReady podmienne kompatibilný s prostredím MR

Súčasť	Čísla modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
Generátory impulzov ICD				
AUTOGEN EL ICD	D174, D175, D176, D177	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	

Tabuľka 1–2. Generátory impulzov ICD – defibrilačný systém ImageReady podmiennečne kompatibilný s prostredím MR (pokračovanie)

Súčasť	Čísla modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
AUTOGEN MINI ICD	D044, D045, D046, D047	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
CHARISMA EL ICD	D320, D321	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	D332, D333	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
DYNAGEN EL ICD	D150, D151, D152, D153	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
DYNAGEN MINI ICD	D020, D021, D022, D023	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
INOGEN EL ICD	D140, D141, D142, D143	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
INOGEN MINI ICD	D010, D011, D012, D013	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
MOMENTUM EL ICD	D120, D121	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
ORIGEN EL ICD	D050, D051, D052, D053	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
ORIGEN MINI ICD	D000, D001, D002, D003	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
PERCIVA HF ICD	D500, D501	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	D512, D513	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
PERCIVA ICD	D400, D401	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	D412, D413	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
RESONATE HF ICD	D520, D521	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	D532, D533	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
RESONATE EL ICD	D420, D421	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	D432, D433	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	X

Tabuľka 1–2. Generátory impulzov ICD – defibrilačný systém ImageReady podmienne kompatibilný s prostredím MR (pokračovanie)

Súčasť	Čísla modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
VIGILANT EL ICD	D220, D221	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
	D232, D233	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	X

Tabuľka 1–3. Elektroda a príslušenstvo – defibrilačný systém ImageReady podmienne kompatibilný s prostredím MR

Súčasť	Čísla modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
Elektrody a príslušenstvo				
Pravé predsieňové elektrody a príslušenstvo				
Stimulačné elektrody FINELINE II Sterox	4479, 4480	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Stimulačné elektrody FINELINE II Sterox EZ	4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Návleky na prišitie pre elektrody FINELINE II	6220, 6221	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Stimulačné elektrody INGEVITY MRI (fixácia hrotmi)	7735, 7736	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Stimulačné elektrody INGEVITY MRI (vysúvateľná/zasúvateľná fixácia)	7740, 7741, 7742	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Návlak na prišitie pre elektrody INGEVITY MRI	6402	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Záslepka portu elektrody IS-1	7145	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Pravé komorové elektrody a príslušenstvo				
Elektrody ENDOTAK RELIANCE (IS-1) – jednocievkové	0128, 0138, 0170, 0171, 0180, 0181, 0182, 0183	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
Elektrody ENDOTAK RELIANCE (IS-1) – jednocievkové ^a	0127, 0129, 0137, 0139, 0172, 0173	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
Záslepka portu elektrody typu DF-1 pre elektrody ENDOTAK RELIANCE (IS-1) – jednocievkové	6996	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
Elektrody ENDOTAK RELIANCE (IS-1) – dvojcievkové	0148, 0157, 0158, 0174, 0175, 0176, 0177, 0184, 0185, 0186, 0187	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
Elektrody ENDOTAK RELIANCE (IS-1) – dvojcievkové ^a	0143, 0147, 0149, 0153, 0159	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	
Defibrilačné elektrody ENDOTAK RELIANCE (DF4)	0262, 0263, 0265, 0266, 0272, 0273, 0275, 0276, 0282, 0283, 0285, 0286,	Podmienne kompatibilné s prostredím MR	X	X

Tabuľka 1–3. Elektroda a príslušenstvo – defibrilačný systém ImageReady podmiennečne kompatibilný s prostredím MR (pokračovanie)

Súčasť	Čísla modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
	0292, 0293, 0295, 0296			
Defibrilačné elektródy RELIANCE 4-FRONT (DF4)	0636, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0657, 0658, 0662, 0663, 0665, 0672, 0673, 0675, 0676, 0682, 0683, 0685, 0686, 0692, 0693, 0695, 0696	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Návlek na prišitie pre elektródy RELIANCE 4-FRONT	6403	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Elektrody a príslušenstvo pre ľavú komoru				
Elektrody ACUITY Spirál	4591, 4592, 4593	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
Návlek na prišitie pre elektródy ACUITY Spirál ^a	6100	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
Stimulačné elektródy ACUITY X4 (IS4)	4671, 4672, 4674, 4675, 4677, 4678	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Návlek na prišitie pre elektródy ACUITY X4	4603	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Elektrody EASYTRAK 2 (IS-1)	4542, 4543, 4544	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
Návlek na prišitie pre elektródy EASYTRAK 2	6773	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	
Záslepka portu elektródy IS4/DF4	7148	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Záslepka portu elektródy IS-1	7145	Podmiennečne kompatibilné s prostredím MR	X	

a. Tieto zariadenia už nie sú dodávané na trh EÚ a už nenesú označenie CE. Spoločnosť Boston Scientific naďalej poskytuje podporu pre tieto zariadenia a ich systémy podmiennečne kompatibilné s prostredím MR.

PODMIENKY POUŽITIA SYSTÉMU MR

Je potrebné dodržať nasledujúce podmienky použitia, aby pacient s defibrilačným systémom ImageReady mohol podstúpiť vyšetrenie na systéme MR. Pred každým snímaním je potrebné overiť, či boli podmienky použitia dodržané, aby sa pri vyhodnocovaní pacientovej vhodnosti a pripravenosti na snímanie podmiennečne kompatibilné s prostredím MR zaistilo použitie najaktuálnejších informácií.

Kardiológia

1. Pacient má implantovaný defibrilačný systém ImageReady podmiennečne kompatibilný s prostredím MR (pozrite si časť "Opis systému" na strane 1-2).

Stimulačný systém ImageReady podmiennečne kompatibilný s prostredím MR tvorí iba generátor impulzov Boston Scientific podmiennečne kompatibilný s prostredím MR a

elektroda (elektrody) so všetkými portami obsadenými elektródou alebo záslepkou portu. Generátor impulzov podmiennečne kompatibilný s prostredím MR od iného výrobcu v kombinácii s elektródou Boston Scientific podmiennečne kompatibilnou s prostredím MR (alebo naopak) nepredstavuje systém podmiennečne kompatibilný s prostredím MR.

2. Nie sú prítomné žiadne ďalšie aktívne alebo „zabudnuté“ implantované zariadenia, komponenty alebo príslušenstvo, ako sú adaptéry elektród, nastavce, elektrody alebo generátory impulzov.

Zníženie rizík spojených s vyšetrením MR nebolo preukázané v prítomnosti iných srdcových implantátov alebo príslušenstva, ako sú adaptéry elektród, predlžovače alebo „zabudnuté“ elektrody či generátory impulzov.

3. Generátor impulzov je v priebehu snímania v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).
4. Hneď ako bude naprogramovaný režim MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR), musí byť pacient neustále monitorovaný pomocou pulzného oxymetra a elektrokardiograficky (EKG). Zaisťte dostupnosť záložnej liečby (externá záchrana).
5. Usúdilo sa, že pacient je klinicky schopný vydržať bez ochrany pred tachykardiou počas celej doby, keď generátor impulzov bude v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).
6. Pacient nemá v dobe snímania zvýšenú teplotu tela ani narušenú termoreguláciu.
7. Lokalizácia implantovaného generátora impulzov je striktne vymedzená na ľavú alebo pravú hrudnú oblasť.
8. Od implantácie a/alebo revízie elektród či chirurgickej modifikácie defibrilačného systému podmiennečne kompatibilného s prostredím MR uplynulo aspoň šesť (6) týždňov.
Obdobie šiestich týždňov umožňuje hojenie a tvorbu jazvového tkaniva, čím sa zníži dopad možných rizík spojených s vyšetreniami MR, ako je teplo alebo pohyb.
9. Nevyskytujú sa žiadne stopy nalomenia elektródy ani narušenia integrity systému generátor impulzov – elektroda.

Zníženie rizík spojených s vyšetrením MR nebolo preukázané v prípade narušenia integrity elektródy a/alebo systému elektródy a generátora impulzov.

Rádiológia

V tejto príručke predstavujeme použitie nového parametra na obmedzenie vystavenia RF počas určitých vyšetrení pri intenzite 3 T.

B_{1+rms} je miera vystavenia RF, ktorá sa líši od špecifickej miery absorpcie (SAR). Používa sa namiesto miery SAR s cieľom obmedziť vyšetrenia pri intenzite 3 T, keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum vyšetrenia) nachádza pod stavcom C7. Parameter B_{1+rms} sa v niektorých snímačoch s intenzitou 3 T nezobrazuje.

Dôležité: Ak nemáte informácie o parametri B_{1+rms} alebo ak si nie ste istí, či je vo vašom snímači s intenzitou 3 T k dispozícii, buď obmedzte vyšetrenia na intenzitu 1,5 T a použite normálny režim, alebo sa obráťte na výrobcu snímača MR a požiadajte ho o ďalšie informácie.

1. Iba horizontálne snímače s uzatvoreným priechodom typu hydrogén proton
2. Intenzita magnetického poľa systému MR 1,5 T (64 MHz) alebo 3 T (128 MHz)
3. Priestorový gradient nie väčší ako 50 T/m (5 000 g/cm)
4. Limity vystavenia RF: 1,5 T

<ul style="list-style-type: none"> • Normálny prevádzkový režim^a je nutné dodržiavať po celú dobu aktívneho vyšetrenia (celotelová priemerná miera SAR $\leq 2,0$ watt/kilogram (W/kg), hlavová miera SAR $\leq 3,2$ W/kg) <p>3 T (anatomická štruktúra pacienta/izocentrum vyšetrenia na stavci C7 alebo nad ním)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normálny prevádzkový režim alebo riadený prevádzkový režim prvej úrovne je nutné dodržiavať po celú dobu aktívneho vyšetrenia. <p>3 T (anatomická štruktúra pacienta/izocentrum vyšetrenia pod stavcom C7)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parameter B_{1+rms} musí byť $\leq 2,8$ mikrotlesa (μT)
<p>VAROVANIE: Ak hodnota parametra B_{1+rms} nie je v systéme snímača MR s intenzitou 3 T zobrazená, neskenujte pri intenzite 3 T, keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum vyšetrenia) nachádza pod stavcom C7. Takéto skenovanie nespĺňa rádiologické podmienky používania.</p>
<p>5. Limity gradientného poľa: Maximálna udávaná rýchlosť zmeny gradientu ≤ 200 T/m/s na os</p>
<p>6. Neexistujú žiadne obmedzenia pre umiestnenie defibrilačného systému do integrovanej cievky skenera MR. Používanie prijímacích cievok nie je obmedzené. Miestne vysielacie cievky alebo miestne vysielacie/prijímacie cievky sa dajú používať, ale nesmú byť umiestnené priamo nad defibrilačným systémom.</p>
<p>7. Pacienti iba v polohe na chrbte alebo bruchu.</p>
<p>8. Pacient musí byť neustále monitorovaný pomocou pulzového oxymetra a elektrokardiografu (EKG) po celú dĺžku trvania, keď je generátor impulzov v režime ochrany pri MR. Zaisťte dostupnosť záložnej liečby (externá záchrana).</p>

a. Ako uvádza norma IEC 60601-2-33, 201.3.224, 3. vydanie.

Systémová odpoveď na podmienky iné ako tie, ktoré sú vyššie uvedené pre rádiologické podmienky, sa nehodnotila.



V prípade vyšetrení pri intenzite 3T, keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum vyšetrenia) nachádza na stavci C7 alebo nad ním, obmedzte skenovanie na normálny prevádzkový režim alebo riadený prevádzkový režim prvej úrovne.

V prípade vyšetrení pri intenzite 3T, keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum vyšetrenia) nachádza pod stavcom C7, parameter B_{1+rms} musí byť $\leq 2,8$ mikrotlesla (μT).

V prípade vyšetrenia pri intenzite 3 T, keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum vyšetrenia) nachádza na stavci C7 alebo nad ním, obmedzte skenovanie na normálny prevádzkový režim alebo riadený prevádzkový režim prvej úrovne. Keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum vyšetrenia) nachádza pod stavcom C7, parameter B_{1+rms} musí byť obmedzený na hodnotu $\leq 2,8$ mikrotlesla (μT). Ak používate snímač, ktorý nezobrazuje parameter B_{1+rms} , neskenujte pri intenzite 3 T, keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum vyšetrenia) nachádza pod stavcom C7.

Obrázok 1-1. Limitné parametre pri skenovaní MR s intenzitou 3 T

MRI PROTECTION MODE (REŽIM OCHRANY PRI MR)

Pri príprave na skenovacie vyšetrenie pomocou MR sa generátor impulzov musí naprogramovať prostredníctvom programátora do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) upravuje určité funkcie generátora impulzov s cieľom zmenšiť riziká spojené s vystavením systému ImageReady podmiennečne kompatibilného s prostredím MR účinkom prostredia MR. Zoznam vlastností a funkcií, ktoré sa v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) pozastavia, uvádza časť "Všeobecné informácie o režime ochrany pri MR" na strane 2-3.

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY MR

Magnetická rezonancia je diagnostický nástroj, ktorý využíva tri typy magnetických a elektromagnetických polí na zobrazovanie mäkkých tkanív v tele:

- Statické magnetické pole vytvárané supravodivou elektromagnetickou cievkou, zvyčajne s intenzitou 1,5 T alebo 3 T.
- Gradientné magnetické polia s oveľa nižšou intenzitou, ale vysokými frekvenciami zmeny v čase. Na vytváranie gradientných polí sa používajú tri súpravy gradientných cievok.
- Vysokofrekvenčné (VF) pulzné pole vytvárané prenosnými VF cievkami (približne 64 MHz pri 1,5 T a 128 MHz pri 3 T).

Tieto polia môžu vytvárať fyzikálne sily alebo elektrické prúdy, ktoré môžu ovplyvniť funkciu aktívnych implantovateľných medicínskych zariadení (AIMD), ako sú generátory impulzov a elektródy. Preto sa môžu skenovať iba pacienti, ktorí majú implantovaný systém podmiennečne kompatibilný s prostredím MR. Pri dodržaní podmienok používania systému MR uvedených v tejto technickej príručke ("Podmienky použitia systému MR" na strane 1-6) môžu pacienti so systémom ImageReady podmiennečne kompatibilným s prostredím MR okrem toho podstúpiť aj vyšetrenie na systéme MR pri riziku zníženom na aktuálne najlepšie štandard starostlivosti.

VAROVANIA A PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE DEFIBRILAČNÝ SYSTÉM PODMIENEČNE KOMPATIBILNÝ S PROSTREDIEM MR

Všeobecné

VAROVANIE: Pokiaľ nie sú splnené všetky podmienky používania v prostredí MR ("Podmienky použitia systému MR" na strane 1-6), skenovacie vyšetrenie pacienta pomocou systému MR nespĺňa požiadavky na podmiennečnú kompatibilitu implantovaného systému s prostredím MR a môže dôjsť k významnému poškodeniu zdravia pacienta alebo jeho smrti a/alebo k poškodeniu implantovaného systému.

Informácie o možných nežiaducich účinkoch relevantných v situáciách, keď sú splnené resp. nespĺnené podmienky používania, uvádza časť "Možné nežiaduce účinky" na strane 1-12.

VAROVANIE: Vyšetrenie na systéme MR po dosiahnutí stavu Explant (Explantovať) môže viesť k predčasnemu vybitiu batérie, skráteniu okna výmeny zariadenia alebo náhlej strate liečby. Po vyšetrení pomocou systému MR so zariadením, ktoré dosiahlo stav Explant (Explantovať), skontrolujte funkciu generátora impulzov a naplánujte výmenu zariadenia.

VAROVANIE: Keď je parameter Časový interval vypnutia naprogramovaný na hodnotu inú než Off (Vyp.), pacient sa nesmie nachádzať pri systéme MR, keď naprogramovaná doba uplynie. V opačnom prípade pacient už nebude spĺňať podmienky používania ("Podmienky použitia systému MR" na strane 1-6).

VAROVANIE: Funkcia Beeper (Zvuková signalizácia) nebude naďalej použiteľná po vyšetrení MR. Prítomnosť silného magnetického poľa systému MR spôsobí trvalú stratu hlasitosti funkcie Beeper (Zvuková signalizácia). Neexistuje možnosť obnovenia, dokonca aj po opustení prostredia MR a ukončení režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Pred vykonaním vyšetrenia na systéme MR by mal lekár a pacient zvážiť výhody vyšetrenia oproti riziku straty funkčnosti Beeper (Zvuková signalizácia). Dôrazne sa odporúča, aby pacienti po vyšetrení na systéme MR boli monitorovaní systémom LATITUDE NXT, pokiaľ ešte nie sú. V opačnom prípade sa dôrazne odporúča naplánuvať kontrolné návštevy raz za tri mesiace a sledovať funkčnosť prístroja.

VAROVANIE: Počas režimu ochrany pri MR nebude pacient dostávať liečbu tachykardie (vrátane ATP a defibrilácie) a v prípade, že je režim bradykardie naprogramovaný na Off (Vypnuté), pacient nedostane bradykardickú stimuláciu (vrátane záložnej stimulácie) a terapiu resynchronizáciou srdca. Preto musí byť pacient monitorovaný po celú dobu, keď je systém v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR), aj počas skenovania.

VAROVANIE: Ak hodnota parametra B_{1+rms} nie je v systéme snímača MR s intenzitou 3 T zobrazená, neskenujte pri intenzite 3 T, keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum

vyšetrenia) nachádza pod stavcom C7. Takéto skenovanie nespĺňa rádiologické podmienky používania.

Dôležité informácie o programovaní

VAROVANIE: Ak je parameter MRI Protection Time-out (Časový interval vypnutia režimu ochrany pri MR) naprogramovaný na hodnotu Off (Vyp.), pacient nebude dostávať tachykardickú terapiu a možnosti stimulácie budú obmedzené na hodnotu Off (Vyp.) alebo Asynchronous (Asynchrónna), pokiaľ sa generátor impulzov nenaprogramuje na ukončenie režimu ochrany pri MR a späť do normálneho prevádzkového režimu.

VAROVANIE: Buďte opatrní pri programovaní režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) u pacientov závislých na stimulácii, ktorí majú stimulačné elektródy nastavené na vysoké stimulačné prahové hodnoty pravej predsene a pravej komory (> 2,0 V). Maximálna stimulačná amplitúda v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) je 5,0 V, čo môže obmedziť dostupnú bezpečnostnú rezervu stimulačnej amplitúdy u pacientov s vysokými stimulačnými prahovými hodnotami. Ak sa nezachová dostatočná bezpečnostná rezerva stimulačnej amplitúdy, môže dôjsť k strate účinnej stimulácie.

VAROVANIE: V priebehu režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) je liečba tachykardie pozastavená. Systém nedeteguje komorové arytmie a pacient nedostane ATP, ani neprebehne defibrilácia, až kým sa generátor impulzov nenaprogramuje späť do normálnej prevádzky. Vyšetrenie vykonajte len v prípade, ak sa usudzuje, že pacient je klinicky schopný vydržať bez ochrany pred tachykardiou počas celej doby, keď generátor impulzov bude v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

VAROVANIE: Počas režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) je liečba bradykardie a liečba srdcovej resynchronizácie (CRT) pozastavená, ak je režim Brady naprogramovaný na hodnotu "Vypnutý". Pacient nebude stimulovaný, až kým sa generátor impulzov nenaprogramuje späť do normálnej prevádzky. V režime MRI Protection Mode naprogramujte režim Brady na hodnotu "Vypnutý" a vyšetrenie vykonajte len v prípade, že sa usudzuje, že pacient je klinicky schopný vydržať bez stimulácie pri bradykardii (vrátane závislosti pacienta od stimulácie alebo potreby potlačiť stimuláciu) a bez stimulácie MRI počas celého trvania doby, keď generátor impulzov bude v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Odporúčame mať v blízkosti miestnosti so zobrazovacím systémom MR zapnutý programátor pre prípad rozvoja náhlej potreby stimulácie u pacienta. Pacienti s nasledujúcimi stavmi môžu mať zvýšené riziko rozvoja prechodnej závislosti na stimulácii.

- V prípade rizika intermitentnej AV blokády (napr. pacienti s progresívnou AV blokádou alebo anamnézou nevysvetlenej synkopy)
- V prípade rizika trifascikulárnej blokády (striedavá blokáda Tawarovho ramienka alebo interval PQ > 200 ms s blokádou ľavého Tawarovho ramienka alebo inou bifascikulárnou blokádou)

VAROVANIE: Riziko arytmie môže byť vyššie pri asynchrónnej stimulácii (AOO, VOO, DOO). Keď programujete asynchrónnu stimuláciu v režime ochrany pri MR, vyberte stimulačnú frekvenciu, ktorá zabráni konkurenčnej stimulácii a minimalizujte čas v MRI Protection Mode (režime ochrany pri MR).

VAROVANIE: Ak pred vstupom do režimu ochrany pri MR je liečba bradykardie, CRT alebo tachykardie naprogramovaná na možnosť Off (Vyp.), liečba ostane vypnutá v momente uplynutia naprogramovaného obdobia časového intervalu vypnutia režimu ochrany pri MR a späť na normálnu prevádzku.

Bezpečnostný režim

VAROVANIE: Pacienta so zariadením, ktoré prešlo do bezpečnostného režimu, nevyšetrujte na systéme MR. Stimulácia v bezpečnostnom režime je unipolárny VVI, ktorý v prostredí MR

vystavuje pacienta zvýšenému riziku indukcie arytmie, nesprávnej stimulácie, zabránenia stimulácii alebo nepravidelnému prerušovanému snímaniu alebo stimulácii.

VAROVANIE: V prípade, že sa vyskytnú neopraviteľné alebo opakované poruchy počas naprogramovania zariadenia v MRI Protection Mode (ochrannom režime počas vyšetrenia MR), následné správanie prístroja bude určené nastavením MRI Protection Brady Mode (ochranného režimu počas vyšetrenia bradykardie pomocou MR).

- Ak je režim vyšetrenia bradykardie pomocou MR nastavený na hodnotu Vypnuté, prístroj vstúpi do režimu bezpečného používania (trvalá unipolárna stimulácia a tachykardia VVI povolená).
- Ak je režim vyšetrenia bradykardie pomocou MR nastavený na asynchrónnu stimuláciu (AOO, VOO, DOO), liečba bradykardie a liečba tachykardie bude trvale vypnutá.

Vylúčenia zo zóny III prostredia MR

VAROVANIE: Programátor je nekompatibilný s prostredím MR a musí zostať mimo zóny III (a vyššej) v prostredí MR, ako je to definované v dokumente American College of Radiology Guidance Document for Safe MR Practices¹. Programátor sa za žiadnych okolností nesmie nosiť do miestnosti so skenerom na vyšetovanie MR, riadiacej miestnosti ani zón III alebo IV v prostredí MR.

VAROVANIE: Implantáciu systému nie je možné vykonať v zóne III prostredia MR (a vyššej), ako je uvedené v publikácii American College of Radiology Guidance Document for Safe MR Practices². Časť príslušenstva dodávaného ako súčasť balenia generátorov impulzov a elektród vrátane momentového kľúča a mandrénového drôtu nie je podmienične kompatibilná s prostredím MR a nemala by sa prenášať do miestnosti so systémom MR, riadiacej miestnosti alebo oblastí zón III a IV prostredia MR.

Preventívne opatrenia

UPOZORNENIE: Lekár, ktorý bude nastavovať parametre režimu MRI Protection Mode (Ochranný režim MR), musí na základe svojich profesionálnych skúseností určiť schopnosť každého pacienta tolerovať nastavenia zariadenia potrebné pre snímanie podmienične kompatibilné s prostredím MR v spojení s fyzikálnym stavom vyžadovaným pri snímaní (napr. predĺžený čas v polohe na chrbte).

UPOZORNENIE: Prítomnosť implantovaného defibrilačného systému môže spôsobovať artefakty na snímkach MR (pozri "Príprava pacienta na vyšetrenie" na strane 2-12).

POZNÁMKA: Všetky bežné riziká spojené s vyšetrením na systéme MR hrozia aj pri vyšetrení na systéme MR s defibrilačným systémom podmienične kompatibilným s prostredím MR. Prečítajte si dokumentáciu systému MR. Nájdete v nej úplný zoznam rizík spojených s vyšetrením na systéme MR.

POZNÁMKA: Iné implantované zariadenia alebo stavy pacienta môžu viesť k tomu, že pacient nebude schopný vyšetrenie na systéme MR podstúpiť bez ohľadu na stav pacientovho defibrilačného systému ImageReady, ktorý je podmienične kompatibilný s prostredím MR.

MOŽNÉ NEŽIADUCE ÚČINKY

Možné nežiaduce účinky sa líšia v závislosti od toho, či sú splnené podmienky používania v prostredí MR ("Podmienky použitia systému MR" na strane 1-6). Úplný zoznam možných nežiaducich účinkov nájdete v Technickom manuáli pre lekára pre generátor impulzov.

1. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007
2. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007.

Pri vyšetrení pacientov na systéme MR, keď sú podmienky používania splnené, môže dôjsť k týmto možným nežiaducim účinkom:

- Indukcia arytmie
- Bradykardia
- Smrť pacienta
- Nepohodlie pacienta spôsobené miernym pohybom alebo teplom zariadenia
- Vedľajšie účinky stimulácie pri stálej vysokej frekvencii ako napríklad súťaženie s vnútornými rytmiami a arytmiami. Konkurenčná stimulácia môže zvýšiť frekvenciu arytmie indukovanej stimuláciou, pokiaľ nebude zariadenie preprogramované.

- Synkopa
- Zhoršenie zlyhávania srdca

Pri vyšetrení pacientov na systéme MR, keď **NIE** sú podmienky používania splnené, môže dôjsť k týmto možným nežiaducim účinkom:

- Indukcia arytmie
- Bradykardia
- Poškodenie generátora impulzov alebo elektród
- Chybné správanie generátora impulzov
- Nevhodná stimulácia, zabránenie stimulácii, zlyhanie stimulácie
- Zvýšená miera uvoľnenia elektródy (počas šiestich týždňov od implantácie alebo revízie systému)
- Nepravidelné alebo prerušované zachytávanie alebo stimulácia
- Strata defibrilačnej liečby
- Zmeny stimulačného prahu
- Smrť pacienta
- Nepohodlie pacienta spôsobené pohybom alebo teplom zariadenia
- Fyzický pohyb generátora impulzov alebo elektród
- Zmeny snímania
- Synkopa
- Zhoršenie zlyhávania srdca

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolete. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsolete. Ne utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Neizmantot.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versione expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

POSTUP SKENOVACIEHO VYŠETRENIA MR

KAPITOLA 2

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

- “Priebeh patientskeho prípadu” na strane 2-2
- “Všeobecné informácie o režime ochrany pri MR” na strane 2-3
- “Činnosti predchádzajúce vyšetreniu” na strane 2-4
- “Po vyšetrení” na strane 2-13

Pred vykonaním skenovacieho vyšetrenia MR overte, že pacient a skener na vyšetovanie MR spĺňajú podmienky používania v prostredí MR ("Podmienky použitia systému MR" na strane 1-6). To je potrebné overiť pred každým skenovacím vyšetrením, aby sa pri vyhodnocovaní spôsobilosti a pripravenosti pacienta na skenovacie vyšetrenie podmienne kompatibilné s prostredím MR zabezpečilo použitie najaktuálnejších informácií.

VAROVANIE: Pokiaľ nie sú splnené všetky podmienky používania v prostredí MR ("Podmienky použitia systému MR" na strane 1-6), skenovacie vyšetrenie pacienta pomocou systému MR nespĺňa požiadavky na podmiennečnú kompatibilitu implantovaného systému s prostredím MR a môže dôjsť k významnému poškodeniu zdravia pacienta alebo jeho smrti a/alebo k poškodeniu implantovaného systému.

Informácie o možných nežiaducich účinkoch relevantných v situáciách, keď sú splnené resp. nesplnené podmienky používania, uvádza časť "Možné nežiaduce účinky" na strane 1-12.

PRIEBEH PACIENTSKEHO PRÍPADU

Vzorový postup vyšetrenia pacienta s defibrilačným systémom ImageReady, ktorý potrebuje podstúpiť skenovacie vyšetrenie MR, sa opisuje nižšie. Podrobnejší opis postupu programovania a vyšetrenia nájdete v tejto kapitole.

1. Špecialista (napríklad ortopéd alebo onkológ) odporučí pacientovi vyšetrenie MR.
2. Pacient, špecialista alebo rádiológ sa obráti na elektrofyziológa/kardiológa, ktorý má na starosti pacientov defibrilačný systém podmiennečnú kompatibilný s prostredím MR.
3. Elektrofyziológ/kardiológ rozhodne o spôsobilosti pacienta podstúpiť skenovacie vyšetrenie podľa informácií v tejto technickej príručke a zaručí informovanie zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich skenovacie vyšetrenie MR o spôsobilosti pacienta. Pred vykonaním vyšetrenia na systéme MR by mal lekár a pacient zvážiť výhody vyšetrenia oproti riziku straty funkčnosti Beeper (Zvuková signalizácia) (Obrázok 2-9 Dialógové okno zhrnutia vypnutia zvukovej signalizácie na strane 2-11).
4. Ak je pacient spôsobilý, generátor impulzov sa tesne pred skenovacím vyšetrením uvedie pomocou programátora do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Zaisťte neustále monitorovanie pacienta, keď bude v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Vytlačí sa správa MRI Protection Settings Report (Správa s nastaveniami režimu ochrany pri MR), vloží sa do záznamov pacienta a poskytne personálu rádiológie. Táto správa dokumentuje nastavenia a podrobnosti o režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Ak sa použila funkcia časového intervalu vypnutia, správa obsahuje presný čas a dátum ukončenia režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).
5. Rádiológ skontroluje záznamy pacienta a akúkoľvek komunikáciu od elektrofyziológa/kardiológa. Ak sa použila funkcia časového intervalu vypnutia, rádiológ overí, že na vykonanie vyšetrenia zostáva dostatočný čas. Pred, počas a po vyšetrení na systéme MR zaisťte neustále monitorovanie pacienta.

POZNÁMKA: *Pacient musí byť monitorovaný po celú dobu, keď je systém v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Neustále monitorovanie zahŕňa zachovanie normálneho hlasového a vizuálneho kontaktu, ako aj monitorovanie pulzného oxymetra a EKG po celú dobu, keď je generátor impulzov v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Dbajte na to, aby bol pri spúšťaní režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) na pacientovi prítomný externý defibrilátor a zdravotnícky personál vyškolený v kardiopulmonálnej resuscitácii (CPR).*

6. Pacient podstúpi vyšetrenie podľa podmienok popísaných v tejto technickej príručke.
7. Generátor impulzov sa vráti do režimu prevádzky nastaveného pred vyšetrením MR, a to buď automaticky, ak bol nastavený parameter časového intervalu vypnutia, alebo manuálne

pomocou programátora. Na implantovanom systéme vykonajte kontrolné testovanie. Dôrazne sa odporúča, aby pacienti po vyšetrení na systéme MR boli monitorovaní systémom LATITUDE NXT, pokiaľ ešte nie sú. V opačnom prípade sa dôrazne odporúča naplánovať kontrolné návštevy raz za tri mesiace a sledovať funkčnosti zariadenia.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O REŽIME OCHRANY PRI MR

Pred tým, ako pacient podstúpi skenovacie vyšetrenie MR, je potrebné naprogramovať defibrilačný systém ImageReady podmienienečne kompatibilný s prostredím MR do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) pomocou programátora. Pozrite si časť "Naprogramovanie generátora impulzov na vyšetrenie" na strane 2-4, kde nájdete podrobnosti o naprogramovaní generátora impulzov do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

Liečba tachykardie je v priebehu režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) pozastavená.

Možnosti stimulačného režimu zahŕňajú asynchrónnu stimuláciu alebo žiadnu stimuláciu (DOO, AOO, VOO alebo žiadnu stimuláciu Off (Vyp.)). Asynchrónna stimulácia sa má používať iba vtedy, ak pacient závisí od stimulácie. Ak je režim bradykardie naprogramovaný na hodnotu "Vypnutý", nebudete mať možnosť pacienta liečiť, kým nevystúpíte z MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Možnosť Off (Vyp.) by sa mala použiť len v prípade, ak sa usudzuje, že pacient je klinicky schopný vydržať bez stimulácie počas doby, keď generátor impulzov bude v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) vrátane doby vyšetrenia.

Úvahy pred výberom asynchrónnej stimulácie zahŕňajú:

- Zistíte, či je pacient závislý od stimulácie.
- Zistíte, ktorú(é) komoru(y) je potrebné stimulovať.
- Zvážte možnosť indukcie arytmie pomocou asynchrónnej stimulácie.
- Pacienti s nasledujúcimi stavmi môžu mať zvýšené riziko rozvoja prechodnej závislosti na stimulácii.
 1. V prípade rizika intermitentnej AV blokády (napr. pacienti s progresívnou AV blokádou alebo anamnézou nevysvetlenej synkopy)
 2. V prípade rizika trifascikulárnej blokády (striedavá blokáda Tawarovho ramienka alebo interval PQ > 200 ms s blokádou ľavého Tawarovho ramienka alebo inou bifascikulárnou blokádou)

Beeper (Zvuková signalizácia) sa v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) deaktivuje a po vyšetrení MR (Obrázok 2-9 Dialógové okno zhrnutia vypnutia zvukovej signalizácie na strane 2-11) už nebude použiteľná.

V režime ochrany pri MR sa pozastavia nasledujúce vlastnosti a funkcie:

- Snímanie bradykardie
- Detekcia a liečba tachykardie
- Automatické prahy PaceSafe
- Denná diagnostika (impedancia elektródy, vlastná amplitúda, prah stimulácie)
- Senzor pohybu a respiračný senzor
- Detekcia magnetu

- RF telemetria
- Sledovanie napätia batérie
- Left Ventricular MultiSite Pacing (Ľavokomorová stimulácia MultiSite Pacing) (RESONATE HF G547, RESONATE X4 G447, CHARISMA X4 G347, VIGILANT X4 G247)

Nasledujúce podmienky zariadenia vylúčia pre používateľa možnosť aktivovať režim ochrany pri MR (ďalšie informácie o týchto podmienkach nájdete v referenčnej príručke generátora impulzov):

- Stav kapacity batérie je Depleted (Vybitá)
- Generátor impulzov je v režime Storage Mode (Režim skladovania)
- Generátor impulzov je v režime Electrocautery Mode (Režim elektrokauterizácie)
- Generátor impulzov je v prevádzke Safety Core (Safety Mode (Bezpečnostný režim))
- Prebieha diagnostický test
- Prebieha EP test

POZNÁMKA: Šesť hodín v režime ochrany pri MR zníži životnosť generátora impulzov približne o 3 dni (CRT-D) alebo 4 dni (ICD).

VAROVANIE: Vyšetrenie na systéme MR po dosiahnutí stavu Explant (Explantovať) môže viesť k predčasnemu vybitiu batérie, skráteniu okna výmeny zariadenia alebo náhlej strate liečby. Po vyšetrení pomocou systému MR so zariadením, ktoré dosiahlo stav Explant (Explantovať), skontrolujte funkciu generátora impulzov a naplánujte výmenu zariadenia.

ČINNOSTI PREDCHÁDZAJÚCE VYŠETRENIU

Pred uskutočnením vyšetrenia na systéme MR treba vykonať tri činnosti:

1. Pripravte generátor impulzov na vyšetrenie tak, že ho naprogramujete do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) ("Naprogramovanie generátora impulzov na vyšetrenie" na strane 2-4)
2. Overte nastavenia a konfiguráciu systému MR ("Potvrdenie nastavení a konfigurácie systému MR" na strane 2-12)
3. Pripravte pacienta na vyšetrenie ("Príprava pacienta na vyšetrenie" na strane 2-12)

Naprogramovanie generátora impulzov na vyšetrenie

Pomocou programátora naprogramujte generátor impulzov do režimu ochrany pri MR.


POZNÁMKA: Úplný zoznam varovaní a preventívnych opatrení nájdete v časti "Varovania a preventívne opatrenia pre defibrilačný systém podmienienečne kompatibilný s prostredím MR" na strane 1-10.

POZNÁMKA: Udržujte prístup k sonde programátora, pretože na vstup do režimu ochrany pri MR je potrebná sondová telemetria.

UPOZORNENIE: Lekár, ktorý bude nastavovať parametre režimu MRI Protection Mode (Ochranný režim MR), musí na základe svojich profesionálnych skúseností určiť schopnosť každého pacienta tolerovať nastavenia zariadenia potrebné pre snímanie podmienienečne kompatibilné s prostredím MR v spojení s fyzikálnym stavom vyžadovaným pri snímaní (napr. predĺžený čas v polohe na chrbte).

Pred začatím programovania vytlačte správu o nastaveniach zariadenia ako referenciu na výber bradykardických nastavení v režime ochrany pri MR.


Na hlavnej obrazovke stlačením tlačidla Tachy Mode (Tachykardický režim) aktivujete režim ochrany pri MR. Zobrazí sa obrazovka Change Device Mode (Zmena režimu zariadenia) (Obrázok 2–1 Dialógové okno Change Device Mode (Zmeniť režim prístroja) na strane 2-5).

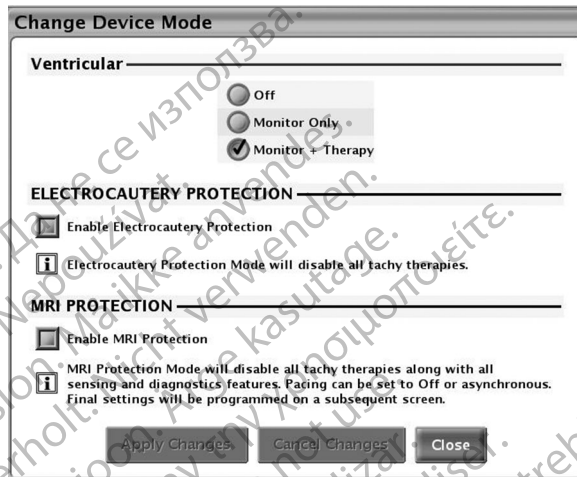

Obrázok 2–1. Dialógové okno Change Device Mode (Zmeniť režim prístroja)

Stlačením tlačidla Enable MRI Protection (Povoliť ochranu pred MR) a potom tlačidla Continue (Pokračovať) pokračujte v aktivácii režimu ochrany pri MR.


Zobrazí sa obrazovka MRI Protection Checklist (Kontrolný zoznam ochrany pri MR) (Obrázok 2–2 Kontrolný zoznam ochrany MRI na strane 2-5). Kontrolný zoznam sumarizuje podmienky, ktoré treba splniť v čase vyšetrenia, aby bol pacient spôsobilý na snímanie podmienčne kompatibilné s prostredím MR. Pred každým skenovacím vyšetrením sa vyžaduje opätovné overenie týchto skutočností, aby sa vylúčila možnosť, že v systéme alebo u pacienta sa po pôvodnej implantácii generátora impulzov/systému vyskytli nejaké zmeny.

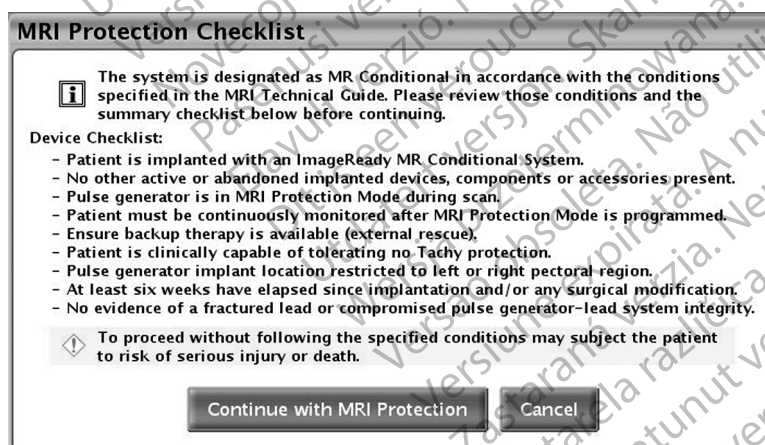

Obrázok 2–2. Kontrolný zoznam ochrany MRI

Ak sú splnené podmienky používania opisované v tejto príručke, stlačte tlačidlo Continue with MRI Protection (Pokračovať v ochrane pred MR). Následne sa zobrazí obrazovka Program MRI Protection (Naprogramovanie ochrany pri MR) (Obrázok 2–3 Dialógové okno Program MRI Protection (Naprogramovanie ochrany pri MR) na strane 2-6).

Ak nie sú splnené podmienky používania, stlačte tlačidlo Cancel (Zrušiť) a systém sa vráti do normálneho prevádzkového režimu. Nepokračujte v skenovacom vyšetrení MR (pacient nesmie podstúpiť skenovacie vyšetrenie MR).

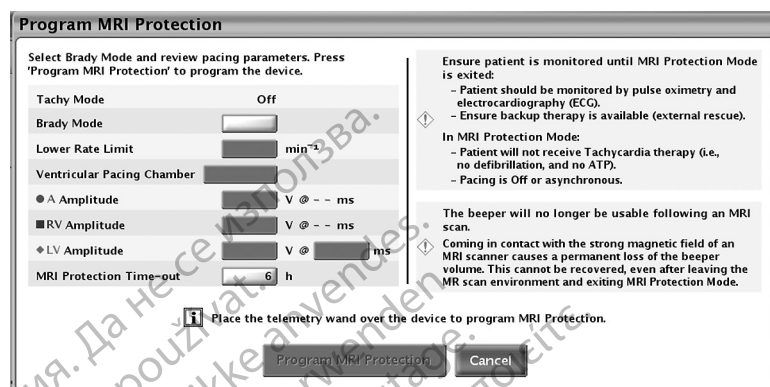

Obrázok 2-3. Dialógové okno Program MRI Protection (Naprogramovanie ochrany pri MR)

Vyberte režim Brady (Obrázok 2-3 Dialógové okno Program MRI Protection (Naprogramovanie ochrany pri MR) na strane 2-6). Možnosti stimulačného režimu zahŕňajú asynchrónnu stimuláciu alebo žiadnu stimuláciu (DOO, AOO, VOO alebo žiadnu stimuláciu Off (Vyp.)). Asynchrónna stimulácia sa má používať iba vtedy, ak pacient závisí od stimulácie.

VAROVANIE: Počas režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) je liečba bradykardie a liečba srdcovej resynchronizácie (CRT) pozastavená, ak je režim Brady naprogramovaný na hodnotu "Vypnutý". Pacient nebude stimulovaný, až kým sa generátor impulzov nenaprogramuje späť do normálnej prevádzky. V režime MRI Protection Mode naprogramujte režim Brady na hodnotu "Vypnutý" a vyšetrenie vykonajte len v prípade, že sa usudzuje, že pacient je klinicky schopný vydržať bez stimulácie pri bradykardii (vrátane závislosti pacienta od stimulácie alebo potreby potlačiť stimuláciu) a bez stimulácie MRI počas celého trvania doby, keď generátor impulzov bude v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Odporúčame mať v blízkosti miestnosti so zobrazovacím systémom MR zapnutý programátor pre prípad rozvoja náhlej potreby stimulácie u pacienta. Pacienti s nasledujúcimi stavmi môžu mať zvýšené riziko rozvoja prechodnej závislosti na stimulácii.

- V prípade rizika intermitentnej AV blokády (napr. pacienti s progresívnou AV blokádou alebo anamnézou nevysvetlenej synkopy)
- V prípade rizika trifascikulárnej blokády (striedavá blokáda Tawarovho ramienka alebo interval PQ > 200 ms s blokádou ľavého Tawarovho ramienka alebo inou bifascikulárnou blokádou)

Ak je nutná asynchrónna stimulácia, naprogramujte nasledujúce doplnkové parametre stimulácie (Obrázok 2-4 Dialógové okno Program MRI Protection (Naprogramovanie ochrany pri MR) s parametrami na strane 2-7).

- Dolný limit frekvencie s predvolenou hodnotou 20 min⁻¹ nad hodnotou LRL normálneho režimu (programovateľný s normálnymi prírastkami až po maximálnu hodnotu 100 min⁻¹)

POZNÁMKA: Keďže stimulácia v režime ochrany pri MR je asynchrónna, pri nastavovaní dolného limitu frekvencie berte do úvahy vlastnú srdcovú frekvenciu pacienta, aby sa predišlo konkurenčnej stimulácii.

- Predsieňová a pravokomorová amplitúda s predvolenou hodnotou 5,0 V (programovateľná s normálnymi prírastkami od 2,0 V do 5,0 V) a šírka impulzu s fixnou hodnotou 1,0 ms


POZNÁMKA: Pre prípad extrakardiálnej stimulácie (napríklad diafragmatická stimulácia) je k dispozícii možnosť naprogramovať stimulačnú amplitúdu na hodnotu nižšiu než 5,0 V.

VAROVANIE: Budte opatrní pri programovaní režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) u pacientov závislých na stimulácii, ktorí majú stimulačné elektródy nastavené na vysoké stimulačné prahové hodnoty pravej predsiene a pravej komory (> 2,0 V). Maximálna stimulačná amplitúda v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) je 5,0 V, čo môže obmedziť dostupnú bezpečnostnú rezervu stimulačnej amplitúdy u pacientov s vysokými stimulačnými prahovými hodnotami. Ak sa nezachová dostatočná bezpečnostná rezerva stimulačnej amplitúdy, môže dôjsť k strate účinnej stimulácie.

- Ľavokomorová amplitúda s predvolenou hodnotou nastavenou na normálnu bradykardickú hodnotu, keď je v rozsahu od 2,0 V do 5,0 V (vrátane) (programovateľná s normálnymi prírastkami od 2,0 V do 5,0 V), a šírka impulzu s predvolenou hodnotou nastavenou na normálnu bradykardickú hodnotu (programovateľná s normálnymi prírastkami od 0,1 ms do 2,0 ms)

POZNÁMKA: Ak je normálna hodnota bradykardie mimo rozsahu 2,0 V až 5,0 V, hodnota amplitúdy MR sa nastaví na najbližší koniec rozsahu hodnôt. Napríklad, ak je normálna hodnota bradykardie 1,0 V, hodnota MR sa nastaví na 2,0 V.

POZNÁMKA: V MRI Protection Mode (režime ochrany pri MR) je minimálna povolená stimulačná amplitúda 2,0 V. Pacienti, ktorých zariadenia sú nominálne naprogramované s amplitúdou stimulácie ľavej komory menšou ako 2,0 V, môžu mať v MRI Protection Mode (režime ochrany pri MR) extrakardiálnu stimuláciu alebo stimuláciu frenických nervov (PNS) ako dôsledok zvýšenej amplitúdy stimulácie ľavej komory. Ak pacient nevyžaduje stimuláciu ľavej komory, zväzte naprogramovanie dutiny komorovej stimulácie s ochranou pred MR iba na pravú komoru a minimalizujte dobu v režime MRI Protection Mode (Režime ochrany pri MR).

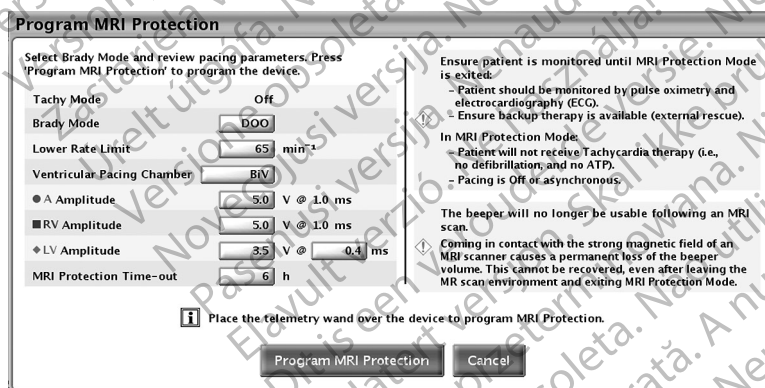

Obrázok 2-4. Dialógové okno Program MRI Protection (Naprogramovanie ochrany pri MR) s parametrami


Nastavený časový interval vypnutia ochrany pri MR (nominálne nastavený na 6 hodín s programovateľnými hodnotami Off (Vyp.), 3, 6, 9, 12 hodín). Funkcia časového intervalu vypnutia ochrany pri MR umožňuje používateľovi zvoliť trvanie doby, počas ktorej zostane generátor impulzov v režime MRI Protection Mode (režim ochrany pri MR). Skontrolujte, či sú hodiny programátora nastavené na správny čas a dátum, aby ste zaistili správnosť plánovaného času ukončenia (zobrazeného na obrazovke a na vytlačenej správe MRI Protection Settings Report (Správa s nastaveniami režimu ochrany Pri MR). Po uplynutí naprogramovaného času generátor impulzov automaticky ukončí režim MRI Protection Mode (Režim ochrany Pri MR) a všetky parametre (okrem funkcie Beeper (Zvuková signalizácia)) sa vrátia k predtým naprogramovaným nastaveniam.

VAROVANIE: Keď je parameter Časový interval vypnutia naprogramovaný na hodnotu inú než Off (Vyp.), pacient sa nesmie nachádzať pri systéme MR, keď naprogramovaná doba uplynie. V opačnom prípade pacient už nebude spĺňať podmienky používania ("Podmienky použitia systému MR" na strane 1-6).

VAROVANIE: Ak je parameter MRI Protection Time-out (Časový interval vypnutia režimu ochrany pri MR) naprogramovaný na hodnotu Off (Vyp.), pacient nebude dostávať tachykardickú terapiu a možnosti stimulácie budú obmedzené na hodnotu Off (Vyp.) alebo Asynchronous (Asynchrónna), pokiaľ sa generátor impulzov nenaprogramuje na ukončenie režimu ochrany pri MR a späť do normálneho prevádzkového režimu.

Stlačte tlačidlo Program MRI Protection (Programovať ochranu pred MR). Keď bude zariadenie úspešne naprogramované do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) s uvedenými nastaveniami, zobrazí sa obrazovka MRI Protection Programmed (Naprogramovaná ochrana pri MR) (Obrázok 2–5 Dialógové okno MRI Protection Programmed (Naprogramovaná ochrana pri MR) na strane 2-8). Nepokračujte v skenovaní, kým sa nezobrazí obrazovka MRI Protection Mode Programmed (Naprogramovaný režim ochrany pri MR), čím sa potvrdí, že je zariadenie v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

POZNÁMKA: Na dokončenie vstupu do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) je nutné použiť hlavícu. Sondy nechajte na mieste dovtedy, kým nedostanete potvrdenie, že je naprogramovaný režim MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

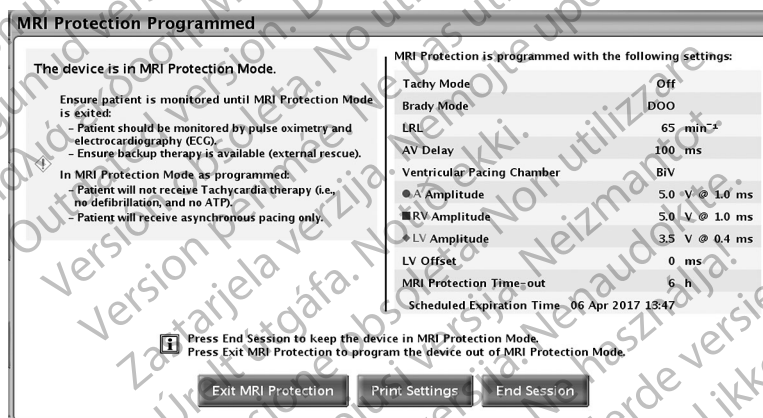

Obrázok 2–5. Dialógové okno MRI Protection Programmed (Naprogramovaná ochrana pri MR)

VAROVANIE: Počas režimu ochrany pri MR nebude pacient dostávať liečbu tachykardie (vrátane ATP a defibrilácie) a v prípade, že je režim bradykardie naprogramovaný na Off (Vypnuté), pacient nedostane bradykardickú stimuláciu (vrátane záložnej stimulácie) a terapiu resynchronizáciou srdca. Preto musí byť pacient monitorovaný po celú dobu, keď je systém v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR), aj počas skenovania.


Po celú dobu, keď je systém v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR), nepretržite monitorujte pacienta. Neustále monitorovanie zahŕňa zachovanie normálneho hlasového a vizuálneho kontaktu, ako aj monitorovanie pulzného oxymetra a EKG po celú dobu, keď je generátor impulzov v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany Pri MR). Zaisťte, aby počas doby, kedy bude generátor impulzov v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) vrátane doby počas vyšetrenia, bol prítomný zdravotnícky personál vyškolený v kardiopulmonálnej resuscitácii (CPR) a externý defibrilátor.

Hneď ako bol úspešne naprogramovaný režim MRI Protection Mode (Režim ochrany Pri MR), vytlačte kópiu správy MRI Protection Settings Report (Správa s nastaveniami režimu ochrany Pri MR) tak, že stlačíte tlačidlo Print Settings (Nastavenia tlače) na obrazovke MRI Protection Mode Programmed (Naprogramovaný režim ochrany Pri MR). Správa uvádza nastavenia použité pre režim MRI Protection Mode (Režim ochrany Pri MR). Ak sa používa funkcia časového intervalu

vypnutia, správa obsahuje čas a dátum ukončenia režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR), keď sa generátor impulzov vrátil k nastaveniam platným pred aktiváciou režimu ochrany pri MR.

Vytlačенú správu možno vložiť do záznamov pacienta a môže ju použiť personál rádiológie, aby sa napríklad uistil, že na vykonanie vyšetrenia na systéme MR zostáva dostatok času. Ukážky výtlačkov správy s nastaveniami ochrany pri MR sú znázornené s časovým intervalom vypnutia nastaveným na 6 hodín (Obrázok D-1 Ukážka výtlačku správy s nastaveniami MRI Protection (Ochrana MR) s časovým intervalom nastaveným na 6 hodín (strany 1-2) na strane D-1) a s časovým intervalom vypnutia nastaveným na Off (Vyp.) (Obrázok D-2 Ukážka výtlačku správy s nastaveniami MRI Protection (Ochrana MR) s časovým intervalom vypnutia nastaveným na Off (Vyp.) (strana 1) na strane D-2).

Tlačidlom End Session (Ukončiť reláciu) ukončíte aktuálnu reláciu programátora a generátor impulzov zostane v aktívnom režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) (Obrázok 2-6 Dialógové okno End Session Confirmation (Potvrdenie ukončenia pripojenia) na strane 2-9).

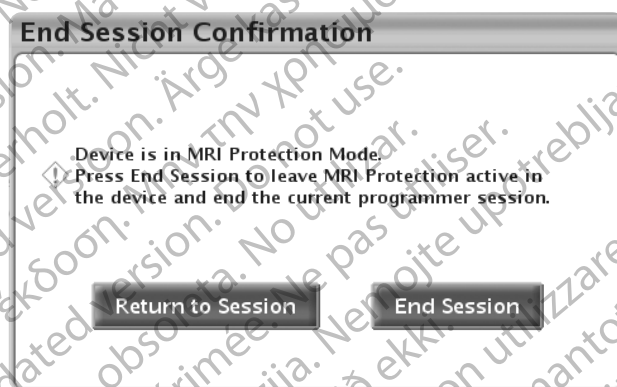

Obrázok 2-6. Dialógové okno End Session Confirmation (Potvrdenie ukončenia pripojenia)

Uistite sa, že odborníci v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorí sa podieľajú na vyšetrení MR, dostali čísla modelu generátora impulzov a elektród implantovaných pacientovi.

Podmienky posudzované počas programovania

Určité podmienky zabránia prechodu do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Medzi ne patria:

- Prebiehajúca komorová epizóda zistená a rozpoznaná generátorom impulzov
- Senzorom magnetu zistená prítomnosť magnetu
- Generátor impulzov je v režime STAT PACE alebo STAT SHOCK

Ak sa vyskytne jedna alebo viacero z týchto podmienok, zobrazí sa dialógové okno s opisom podmienky a nebude možné aktivovať režim ochrany pri MR. Pozri napríklad Obrázok 2-7 Hlásenie s upozornením na prebiehajúcu epizódu na strane 2-10.




Obrázok 2–7. Hlásenie s upozornením na prebiehajúcu epizódu

Okrem vyššie uvedených podmienok, ktoré bránia aktivácii režimu ochrany pri MR, programátor počas programovania vyhodnocuje aj tri ďalšie podmienky: impedanciu elektród, čas uplynutý od implantácie a stimulačný prah.

1: Impedancia elektródy

Požiadavka používateľa na vstup do režimu ochrany Pri MR spustí test impedancie elektródy vo všetkých dutinách a test impedancie výbojovej elektródy. Ak sú hodnoty impedancie elektród získané pri tomto testovaní mimo naprogramovaného normálneho rozsahu, programátor zobrazí dialógové okno s odporúčaním skontrolovať súvisiace riziká, ak sa používateľ rozhodne pokračovať. Dialógové okno poskytuje možnosť pokračovať v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) za prítomnosti týchto podmienok alebo zrušiť vstup do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Obrázok 2–8 Hlásenie s upozornením na impedanciu elektródy mimo rozsahu na strane 2-10 zobrazuje dialógové okno, ktoré sa zobrazí, ak je hodnota impedancie elektródy mimo rozsahu.

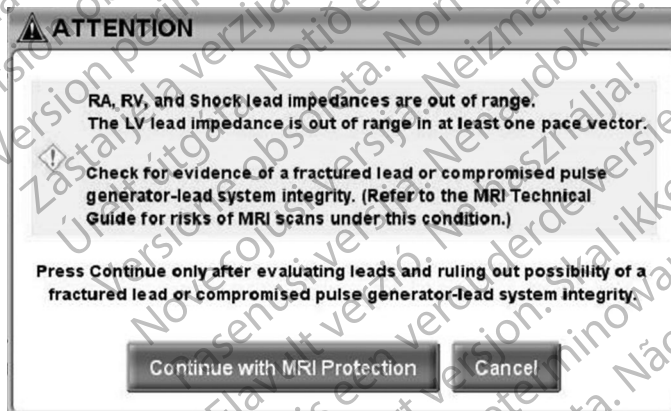

Obrázok 2–8. Hlásenie s upozornením na impedanciu elektródy mimo rozsahu

2. Čas uplynutý od implantácie

Programátor určí aj čas uplynutý od implantácie na základe dátumu a času, keď bol vypnutý režim skladovania generátora impulzov.

POZNÁMKA: Ak nie sú hodiny programátora nastavené na správny čas a dátum, toto určenie nemusí byť presné.

Ak je vypočítaný čas od vypnutia režimu skladovania menší než 6 týždňov, programátor zobrazí dialógové okno s odporúčaním skontrolovať súvisiace riziká, ak sa používateľ rozhodne pokračovať. Dialógové okno poskytuje možnosť pokračovať v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) za prítomnosti týchto podmienok alebo zrušiť vstup do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

3. Stimulačný prah


Ak sú naposledy zaznamenané merania prahovej hodnoty stimulácie pravej predsieni a pravej komory vyššie ako 2,0 V, programátor zobrazí dialógové okno s odporúčaním postupovať u pacientov závislých na stimulácii opatrne. Toto dialógové okno poskytuje možnosť pokračovať v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) za prítomnosti týchto podmienok alebo zrušiť aktiváciu režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

VAROVANIE: Buďte opatrní pri programovaní režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) u pacientov závislých na stimulácii, ktorí majú stimulačné elektródy nastavené na vysoké stimulačné prahové hodnoty pravej predsieni a pravej komory (> 2,0 V). Maximálna stimulačná amplitúda v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) je 5,0 V, čo môže obmedziť dostupnú bezpečnostnú rezervu stimulačnej amplitúdy u pacientov s vysokými stimulačnými prahovými hodnotami. Ak sa nezachová dostatočná bezpečnostná rezerva stimulačnej amplitúdy, môže dôjsť k strate účinnej stimulácie.

Beeper (Zvuková signalizácia)

Funkcia Beeper (Zvuková signalizácia) nebude naďalej použiteľná po vyšetrení MR. Prítomnosť silného magnetického poľa systému MR spôsobí trvalú stratu hlasitosti funkcie Beeper (Zvuková signalizácia). Neexistuje možnosť obnovenia, dokonca aj po opustení prostredia MR a ukončenia režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany Pri MR). Systém aktívne zakáže programovateľné a neprogramovateľné možnosti Beeper (Zvuková signalizácia), keď je naprogramovaný režim MRI Protection Mode (Režim ochrany Pri MR). Funkcia Beeper (Zvuková signalizácia) zostane VYPNUTÁ (OFF) až do ukončenia režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

Po následných interogáciách bude upozornenie na vypnutie funkcie Beeper (Zvuková signalizácia) a na dátum, kedy bol naposledy naprogramovaný režim MRI Protection Mode (Režim ochrany Pri MR), a to na úvodnom dialógovom okne Summary (Zhrnutie) (Obrázok 2-9 Dialógové okno zhrnutia vypnutia zvukovej signalizácie na strane 2-11).

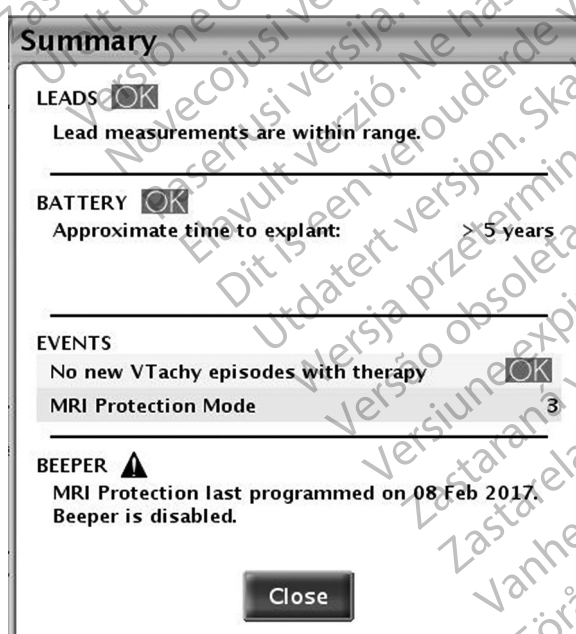

Obrázok 2-9. Dialógové okno zhrnutia vypnutia zvukovej signalizácie

Nasledujúce situácie už nevyvolajú spustenie funkcie Beeper (Zvuková signalizácia), ktorá vydáva počuteľné tóny, keď je zariadenie naprogramované do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany Pri MR).

Tabuľka 2-1. Situácie, ktoré už nevyvolajú spustenie zvukovej signalizácie, ktorá vydáva počuteľné tóny, keď je zariadenie naprogramované do režimu ochrany Pri MR.

Možnosti programovania funkcie Beeper (Zvuková signalizácia)	<ul style="list-style-type: none"> • Beep During Capacitor Charge (Pípanie počas nabíjania kapacitátora) • Beep When Out-of-Range (Pípanie, keď je hodnota mimo rozsahu) • Beep when Explant is Indicated (Pípanie, keď je indikovaná explantácia)
Nemožnosť programovania funkcie Beeper (Zvuková signalizácia)	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikácia magnetu pacienta nad generátor impulzov v niektorých situáciách (napr. potvrdenie režimu tachykardie) • Vybíť kapacita batérie (koniec životnosti (EOL)) • Upozornenie na chybu batérie • Upozornenie na chybu vysokého napätia

Funkcia Beeper (Zvuková signalizácia) bude vydávať tóny po prechode generátora impulzov do prevádzky v bezpečnom režime alebo vynulovaní zariadenia, aj po naprogramovaní zariadenia do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany Pri MR). Ale hlasitosť funkcie Beeper (Zvuková signalizácia) v zariadení bude zvýšená a môže byť počut.

POZNÁMKA: V prípadoch, keď nenastane vyšetrenie pomocou systému MR, je možné znova povoliť funkciu Beeper (Zvuková signalizácia) po ukončení režimu ochrany pri MR ("Po vyšetrení" na strane 2-13).

Potvrdenie nastavení a konfigurácie systému MR

Uistite sa, že zariadenie MR spĺňa podmienky používania so systémom MR, ako ich uvádza časť "Podmienky použitia systému MR" na strane 1-6.

Príprava pacienta na vyšetrenie

Ak sa používa funkcia časového intervalu vypnutia režimu ochrany pri MR, uistite sa, že poznáte čas, kedy má generátor impulzov ukončiť režim ochrany pri MR. Pozrite si Obrázok 2-5 Dialógové okno MRI Protection Programmed (Naprogramovaná ochrana pri MR) na strane 2-8.

POZNÁMKA: Ak zostávajúci čas nepostačuje na to, aby pacient podstúpil vyšetrenie MR, znovu interogujte zariadenie a podľa potreby preprogramujte hodnotu časového intervalu vypnutia (pozri "Naprogramovanie generátora impulzov na vyšetrenie" na strane 2-4).

VAROVANIE: Keď je parameter Časový interval vypnutia naprogramovaný na hodnotu inú než Off (Vyp.), pacient sa nesmie nachádzať pri systéme MR, keď naprogramovaná doba uplynie. V opačnom prípade pacient už nebude spĺňať podmienky používania ("Podmienky použitia systému MR" na strane 1-6).

Pacient musí byť v tuneli v polohe na chrbte alebo na bruchu a musí sa používať vhodný monitorovací systém (pulzná oxymetria a EKG). Pozri "Podmienky použitia systému MR" na strane 1-6.

VAROVANIE: Počas režimu ochrany pri MR nebude pacient dostávať liečbu tachykardie (vrátane ATP a defibrilácie) a v prípade, že je režim bradykardie naprogramovaný na Off (Vypnuté), pacient nedostane bradykardickú stimuláciu (vrátane záložnej stimulácie) a terapiu resynchronizáciou srdca. Preto musí byť pacient monitorovaný po celú dobu, keď je systém v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR), aj počas skenovania.

Pri plánovaní skenovacieho vyšetrenia MR a pri interpretácii snímok MR v blízkosti generátora impulzov a/alebo elektród treba brať do úvahy skreslenie obrazu. Artefakty môžu zahŕňať mierne priestorové skreslenie za hranicami viditeľného artefaktu. Pri neklinickom testovaní v systéme s intenzitou magnetického poľa 1,5 T a 3 T siahal maximálny obrazový artefakt súvisiaci s generátorom impulzov defibrilačného systému ImageReady približne 18,6 cm radiálne od zariadenia pri testovaní pomocou sekvencie spinového echa v systéme na vyšetovanie MR s intenzitou 3 T a maximálny obrazový artefakt súvisiaci s elektródou defibrilačného systému ImageReady siahal 2,1 cm od zariadenia pri testovaní pomocou sekvencie spinového echa v systéme na vyšetovanie MR s intenzitou magnetického poľa 3 T.

PO VYŠETRENÍ

1. Ukončenie režimu ochrany pri MR

MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) možno ukončiť buď automaticky, alebo manuálne. Vypnutie nastane automaticky po uplynutí naprogramovaného počtu hodín, ak je funkcia časového intervalu vypnutia nastavená na číselnú hodnotu. Ak je časovač naprogramovaný na hodnotu Off (Vyp.), ukončenie sa vykoná manuálne pomocou programátora (pozrite si časť Manuálne ukončenie režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR)). Po ukončení režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) overte integritu systému spustením testov impedancie elektród, stimulačného prahu a vlastnej amplitúdy.

V prípade zariadení RESONATE HF, RESONATE, PERCIVA HF, PERCIVA, CHARISMA, VIGILANT a MOMENTUM sa po ukončení režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) súhrnná správa MR uloží ako epizóda MR a možno ju vytlačiť ako správu epizódy. Ukážku výtlačku správy môžete nájsť v Obrázok D-3 Ukážka výtlačku uloženej udalosti na strane D-2. Epizódu ochrany pri MR si možno pozrieť aj v záznamoch Arrhythmia Logbook (Záznamy arytmií). Epizódu MRI si možno pozrieť aj v záznamoch Arrhythmia Logbook (Záznamy arytmií) cez diaľkové monitorovanie pacienta (ak je dostupné).

Ukončenie režimu ochrany pri MR (automatické) prostredníctvom časového intervalu vypnutia

Ak sa parameter MRI Protection Mode Time-out (Časový interval vypnutia režimu ochrany pri MR) naprogramoval na inú hodnotu ako Off (Vyp.), generátor impulzov po zvolenom počte hodín ukončí režim ochrany pri MR automaticky a systém sa vráti k predtým naprogramovaným nastaveniam (okrem funkcie Beepér (Zvuková signalizácia) a Minute Ventilation (Minútová ventilácia) popísaných nižšie).


Manuálne ukončenie režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR)

Prípadne ak je funkcia časového intervalu vypnutia naprogramovaná na možnosť Off (Vyp.) alebo vždy, keď budete chcieť manuálne ukončiť režim MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR), použite na ukončenie režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) generátora impulzov programátor.

Po skenovacom vyšetrení nenechávajte generátor impulzov v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) dlhšie, ako je potrebné. Pre manuálne ukončenie režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) vykonajte nasledujúce kroky:

- a. Interogujte generátor impulzov pomocou hlavice (RF telemetria je v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) vypnutá).
- b. Stlačte tlačidlo Exit MRI Protection Mode (Ukončiť režim ochrany pri MR) na obrazovke MRI Protection Programmed (Naprogramovaná ochrana pri MR) (Obrázok 2-10 Dialógové okno MRI Protection Programmed (Naprogramovaná ochrana pri MR) na strane 2-14).


POZNÁMKA: V prípade potreby je možné taktiež použiť STAT PACE, STAT SHOCK alebo DIVERT THERAPY na ukončenie režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). STAT PACE iniciuje parametre stimulácie v režime STAT PACE (ďalšie informácie o režime STAT PACE získate v referenčnej príručke ku generátoru impulzov).

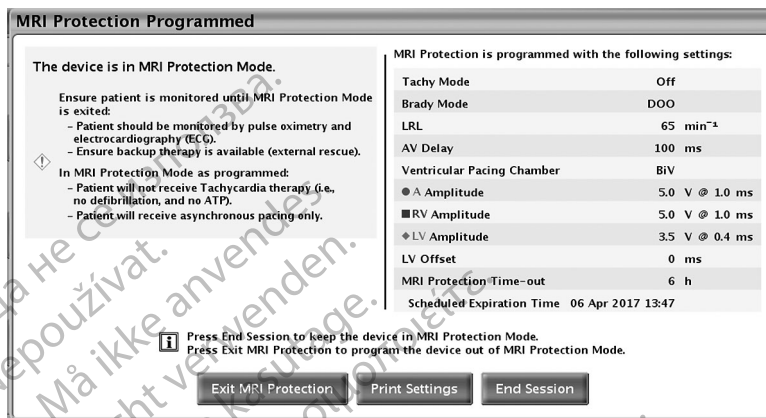

Obrázok 2–10. Dialógové okno MRI Protection Programmed (Naprogramovaná ochrana pri MR)

2. Vyhodnotenie zariadenia

Po zrušení režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) iniciovanom používateľom programátor automaticky prejde na obrazovku Lead Tests (Testy elektród) a vyzve používateľa, aby vykonal testy elektród (Obrázok 2–11 Dialógové okno opustenia ochrany MR na strane 2-14).

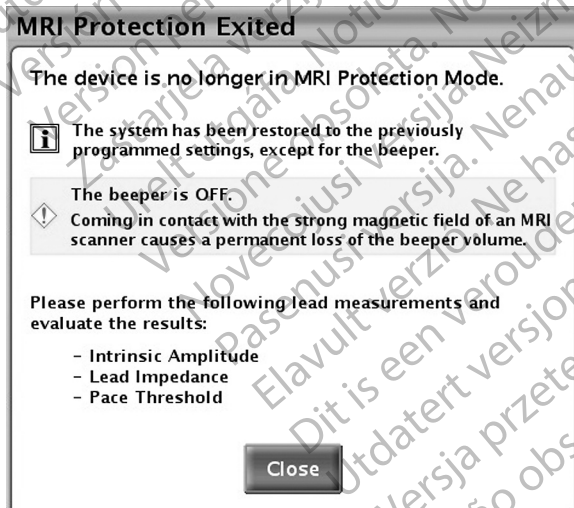

Obrázok 2–11. Dialógové okno opustenia ochrany MR


Vykonajte nasledujúce merania elektród a zhodnoťte výsledky:

- Vlastná amplitúda
- Impedancia elektródy
- Prah stimulácie

Vykonajte tieto testy aj po automatickom (načasovanom) ukončení režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Po dokončení testovania sa odporúča uložiť všetky údaje pacienta pomocou programátora.

Po automatickom alebo manuálnom ukončení režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) sa všetky parametre ihneď obnovia na hodnoty nastavené pred režimom MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) s nasledujúcimi výnimkami:

- a. Obnovenie fungovania senzora Minute Ventilation (Minútová ventilácia) je po ukončení režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) oddialené. Ak je senzor MV naprogramovaný na hodnotu On (Zap.) alebo Passive (Pasívny) v čase vstupu do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) začne po ukončení tohto režimu automatická šesťhodinová kalibrácia senzora. Reakcia frekvencie riadená pomocou MV nie je počas doby kalibrácie dostupná. Ak sa reakcia frekvencie riadená pomocou MV vyžaduje skôr, možno vykonať manuálnu kalibráciu. Manuálna kalibrácia sa ukončí do piatich minút alebo skôr. Ďalšie informácie o kalibrácii MV si pozrite v referenčnej príručke generátora impulzov.
- b. Funkcia Beeper (Zvuková signalizácia) zostane VYPNUTÁ (OFF) až do ukončenia režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Ak si používateľ želá, môže sa manuálne pokúsiť znovu aktivovať funkciu Beeper (Zvuková signalizácia) (Obrázok 2–12 Konfigurácia nastavení zvukovej signalizácie na strane 2-15).

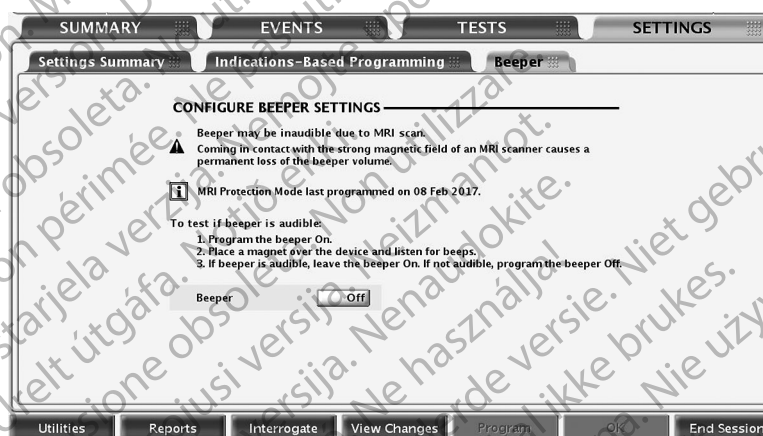

Obrázok 2–12. Konfigurácia nastavení zvukovej signalizácie

Možnosť Configure Beeper Settings (Konfigurovať nastavenia zvukovej signalizácie) bude dostupná len po naprogramovaní zariadenia do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Keď je funkcia Beeper (Zvuková signalizácia) znovu naprogramovaná na možnosť On (Zap.), všetky programovateľné a neprogramovateľné funkcie Beeper (Zvuková signalizácia) sa vrátia na svoje nominálne hodnoty.

Pre naprogramovanie funkcie Beeper (Zvuková signalizácia) vykonajte nasledujúce kroky:

- i. Vyberte kartu Settings (Nastavenia).
- ii. Vyberte kartu Beeper (Zvuková signalizácia).
- iii. Vyberte požadovanú hodnotu pre funkciu Beeper (Zvuková signalizácia).

Prítomnosť silného magnetického poľa systému MR spôsobí trvalú stratu hlasitosti funkcie Beeper (Zvuková signalizácia). Po opätovnom zapnutí funkcie Beeper (Zvuková signalizácia) sa uistite, že je stále funkčná tak, že umiestnite magnet nad zariadenie a

budete počúvať pípnutie. Ak počujete Beeper (Zvuková signalizácia), nechajte Beeper na možnosti On (Zapnutá zvuková signalizácia). Ak nepočujete Beeper (Zvuková signalizácia), naprogramujte funkciu Beeper (Zvuková signalizácia) na možnosť Off (Vyp.).

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Ärge kasutage.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsolete. Ne utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versione expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívat.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

KONTROLNÝ KARDIOLOGICKÝ ZOZNAM DEFIBRILAČNÉHO SYSTÉMU IMAGEREADY

PRÍLOHA A

Táto príloha sa uvádza pre uľahčenie. Ohľadom celého zoznamu varovaní a preventívnych opatrení a úplné pokyny pre používanie defibrilačného systému ImageReady si pozrite zvyšnú časť tejto technickej príručky.

Podmienky používania – kardiológia

Je potrebné dodržať nasledujúce podmienky použitia, aby pacient s defibrilačným systémom ImageReady mohol podstúpiť vyšetrenie na systéme MR.

Pacient má implantovaný defibrilačný systém ImageReady podmienene kompatibilný s prostredím MR ("Súčasťou defibrilačného systému ImageReady pre intenzity 1,5 T a 3 T" na strane C-1).

Nie sú prítomné žiadne ďalšie aktívne alebo „zabudnuté“ implantované zariadenia, komponenty alebo príslušenstvo ako sú adaptéry elektród, nastavce, elektródy alebo generátory impulzov.

Generátor impulzov je v priebehu snímania v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

Hneď ako bude naprogramovaný režim MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR), musí byť pacient neustále monitorovaný pomocou pulzného oxymetra a elektrokardiograficky (EKG). Zaisťte dostupnosť záložnej liečby (externá záchrana).

Usúdilo sa, že pacient je klinicky schopný vydržať bez ochrany pred tachykardiou počas celej doby, keď generátor impulzov bude v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

Pacient nemá v dobe snímania zvýšenú teplotu tela ani narušení termoreguláciu.

Lokalizácia implantovaného generátora impulzov je striktné vymedzená na ľavú alebo pravú hrudnú oblasť.

Od implantácie a/alebo revízie elektród či chirurgickej modifikácie defibrilačného systému podmienene kompatibilného s prostredím MR uplynulo aspoň šesť (6) týždňov.

Nevyskytujú sa žiadne stopy naloženia elektródy ani narušenia integrity systému generátor impulzov – elektróda.

Postup vyšetrenia

Pred vyšetrením

1. Zaisťte, aby pacient spĺňal všetky kardiologické podmienky použitia pre vyšetrenie MR (pozri ľavý stĺpec).

2. Expozícia vyšetreniu MR spôsobuje trvalú stratu hlasitosti signalizácie Beeper (Zvuková signalizácia). Lekár a pacient by mali zvážiť výhody postupu MR oproti riziku straty funkčnosti signalizácie Beeper (Zvuková signalizácia).

3. Uisťte sa, že odborníci v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorí sa podieľajú na vyšetrení MR, dostali čísla modelu generátora impulzov a elektród implantovaných pacientovi.

4. Čo najbližšie k spusteniu vyšetrenia naprogramujte generátor impulzov pacienta do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) a začnite neustále monitorovanie pacienta.

5. Vytlačte správu MRI Protection Settings Report (Správa s nastaveniami režimu ochrany pri MR), vložte ju do záznamov pacienta a poskytnite personálu rádiológie.

• Táto správa dokumentuje nastavenia a podrobnosti o režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Ak sa použila funkcia časového intervalu vypnutia, správa obsahuje presný čas a dátum ukončenia režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

Počas vyšetrenia

6. Zaisťte, aby bol pacient neustále monitorovaný pomocou pulzného oxymetra a elektrokardiograficky (EKG), pričom bude k dispozícii záložná liečba (externá záchrana), keď bude zariadenie v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

Po vyšetrení

7. Zabezpečte, aby sa generátor impulzov vrátil do režimu prevádzky nastaveného pred vyšetrením MR, a to buď automaticky, ak bol nastavený parameter časového intervalu vypnutia, alebo manuálne pomocou programátora. Vykonajte kontrolné testovanie defibrilačného systému po opustení režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) a pokračujte v monitorovaní pacienta, pokiaľ sa generátor impulzov nevráti k prevádzke pred MR.

8. Funkcia Beeper (Zvuková signalizácia) zostane VYPNUTÁ (OFF) až do ukončenia režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

VAROVANIE: Ak nie sú splnené všetky podmienky používania, nevyhovuje vyšetrenie pacienta na systéme MR požiadavkám pre podmienene kompatibilitu implantovaného systému s prostredím MR a môže dôjsť k významnému poškodeniu zdravia pacienta alebo jeho smrti a/alebo poškodeniu implantovaného systému.

VAROVANIE: Buďte opatrní pri programovaní režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) u pacientov závislých na stimulácii, ktorí majú stimulačné elektródy nastavené na vysoké stimulačné prahové hodnoty pravej predsene a pravej komory (> 2,0 V). Maximálna stimulačná amplitúda v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) je 5,0 V, čo môže obmedziť

dostupnú bezpečnostnú rezervu stimulačnej amplitúdy u pacientov s vysokými stimulačnými prahovými hodnotami. Ak sa nezachová dostatočná bezpečnostná rezerva stimulačnej amplitúdy, môže dôjsť k strate účinnej stimulácie.

VAROVANIE: Riziko arytmie môže byť vyššie pri asynchrónnej stimulácii (AOO, VOO, DOO). Keď programujete asynchrónnu stimuláciu v režime ochrany pri MR, vyberte stimulačnú frekvenciu, ktorá zabráni konkurenčnej stimulácii a minimalizujte čas v MRI Protection Mode (režime ochrany pri MR).

VAROVANIE: Ak je parameter MRI Protection Time-out (Časový interval vypnutia režimu ochrany pri MR) naprogramovaný na hodnotu Off (Vyp.), pacient nebude dostávať tachykardickú terapiu a možnosti stimulácie budú obmedzené na hodnotu Off (Vyp.) alebo Asynchronous (Asynchrónna), pokiaľ sa generátor impulzov nenaprogramuje na ukončenie režimu ochrany pri MR a späť do normálneho prevádzkového režimu.

VAROVANIE: Programátor je nekompatibilný s prostredím MR a musí zostať mimo zóny III (a vyššej) v prostredí MR, ako je to definované v dokumente American College of Radiology Guidance Document for Safe MR Practices¹. Programátor sa za žiadnych okolností nesmie nosiť do miestnosti so skenerom na vyšetrenie MR, riadiacej miestnosti ani zón III alebo IV v prostredí MR.

VAROVANIE: Funkcia Beeper (Zvuková signalizácia) nebude naďalej použiteľná po vyšetrení MR. Prítomnosť silného magnetického poľa systému MR spôsobí trvalú stratu hlasitosti funkcie Beeper (Zvuková signalizácia). Neexistuje možnosť obnovenia, dokonca aj po opustení prostredia MR a ukončenia režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Pred vykonaním vyšetrenia na systéme MR by mal lekár a pacient zvážiť výhody vyšetrenia oproti riziku straty funkčnosti Beeper (Zvuková signalizácia). Dôrazne sa odporúča, aby pacienti po vyšetrení na systéme MR boli monitorovaní systémom LATITUDE NXT, pokiaľ ešte nie sú. V opačnom prípade sa dôrazne odporúča naplánovať kontrolné návštevy raz za tri mesiace a sledovať funkčnosť prístroja.

1. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007

KONTROLNÝ RÁDIOLOGICKÝ ZOZNAM DEFIBRILAČNÉHO SYSTÉMU IMAGEREADY

PRÍLOHA B

Táto príloha sa uvádza pre uľahčenie. Ohľadom celého zoznamu varovaní a preventívnych opatrení a úplné pokyny pre používanie defibrilačného systému ImageReady si pozrite zvyšnú časť tejto technickej príručky.

V tejto príručke predstavujeme použitie nového parametra na obmedzenie vystavenia RF počas určitých vyšetrení pri intenzite 3 T.

B_{1+rms} je miera vystavenia RF, ktorá sa líši od špecifickej miery absorpcie (SAR). Používa sa namiesto miery SAR s cieľom obmedziť vyšetrenia pri intenzite 3 T, keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum vyšetrenia) nachádza pod stavcom C7. Parameter B_{1+rms} sa v niektorých snímačoch s intenzitou 3 T nezobrazuje.

Dôležité: Ak nemáte informácie o parametri B_{1+rms} alebo ak si nie ste istí, či je vo vašom snímači s intenzitou 3 T k dispozícii, buď obmedzte vyšetrenia na intenzitu 1,5 T a použite normálny režim, alebo sa obráťte na výrobcu snímača MR a požiadajte ho o ďalšie informácie.

Podmienky používania – rádiológia

Je potrebné dodržať nasledujúce podmienky použitia, aby pacient s defibrilačným systémom ImageReady mohol podstúpiť vyšetrenie na systéme MR.

Iba horizontálne snímače s uzatvoreným prechodom typu hydrogen proton.

Intenzita magnetického poľa systému MR 1,5 T (64 MHz) alebo 3 T (128 MHz). Pozri "Súčasť defibrilačného systému ImageReady pre intenzity 1,5 T a 3 T" na strane C-1.

Priestorový gradient nie väčší ako 50 T/m (5 000 G/cm).

Limity vystavenia RF:

1,5 T

- Normálny prevádzkový režim^a je nutné dodržiavať po celú dobu aktívneho vyšetrenia (celotelová priemerná miera SAR $\leq 2,0$ watt/kilogram (W/kg), hlavová miera SAR $\leq 3,2$ W/kg)

3 T (anatomická štruktúra pacienta/izocentrum vyšetrenia na stavci C7 alebo nad ním)

- Normálny prevádzkový režim alebo riadený prevádzkový režim prvej úrovne je nutné dodržiavať po celú dobu aktívneho vyšetrenia.

3 T (anatomická štruktúra pacienta/izocentrum vyšetrenia pod stavcom C7)

- Parameter B_{1+rms} musí byť $\leq 2,8$ mikrotesla (μT)

VAROVANIE: Ak hodnota parametra B_{1+rms} nie je v systéme snímača MR s intenzitou 3 T zobrazená, neskenujte pri intenzite 3 T, keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum vyšetrenia) nachádza pod stavcom C7. Takéto skenovanie nespĺňa rádiologické podmienky používania.

Maximálna udávaná rýchlosť zmeny gradientu ≤ 200 T/m/s na os.

Neexistujú žiadne obmedzenia pre umiestnenie defibrilačného systému do integrovanej cievky skenera MR. Používanie prijímacích cievok nie je obmedzené. Miestne vysielacie cievky alebo miestne vysielacie/prijímacie cievky sa dajú používať, ale nesmú byť umiestnené priamo nad defibrilačným systémom.

Pacienti iba v polohe na chrbte alebo bruchu.

Pacient musí byť neustále monitorovaný pomocou pulzového oxymetra a elektrokardiografu (EKG) po celú dĺžku trvania, keď je generátor impulzov v režime ochrany pri MR. Zaisťte dostupnosť záložnej liečby (externá záchrana).

a. Ako uvádza norma IEC 60601-2-33, 201.3.224, 3. vydanie.

VAROVANIE: Ak nie sú splnené všetky podmienky používania, nevyhovuje vyšetrenie pacienta na systéme MR požiadavkám pre podmienenú kompatibilitu implantovaného systému s prostredím MR a môže dôjsť k významnému poškodeniu zdravia pacienta alebo jeho smrti a/alebo poškodeniu implantovaného systému.

VAROVANIE: Programátor je nekompatibilný s prostredím MR a musí zostať mimo zóny III (a vyššej) v prostredí MR, ako je to definované v dokumente American College of Radiology Guidance Document for Safe MR Practices¹. Programátor sa za žiadnych okolností nesmie nosiť do miestnosti so skenerom na vyšetrenie MR, riadiacej miestnosti ani zón III alebo IV v prostredí MR.

Postup vyšetrenia**Pred vyšetrením**

1. Zaisťte, aby kardiológia rozhodla o pacientovej spôsobilosti pre vyšetrenie na základe kardiologických podmienok pre použitie systému MR ("Kontrolný kardiologický zoznam defibrilačného systému ImageReady" na strane A-1)

2. Čo najbližšie k spusteniu vyšetrenia sa generátor impulzov pacienta naprogramuje do režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) a začne neustále monitorovanie pacienta.

3. Pozrite si správu MRI Protection Settings Report (Správa s nastaveniami ochrany pri MR), aby sa potvrdilo, že pacientovo zariadenie je v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). Ak sa použila funkcia časového intervalu vypnutia, správa obsahuje presný čas a dátum ukončenia režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR). **Overte, že na dokončenie vyšetrenia zostáva primeraný čas.**


Počas vyšetrenia

4. Zaisťte, aby bol pacient neustále monitorovaný pomocou pulzného oxymetra a elektrokardiograficky (EKG), pričom bude k dispozícii záložná liečba (externá záchrana), keď bude zariadenie v režime MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR).

Po vyšetrení

5. Zabezpečte, aby sa generátor impulzov vrátil do režimu prevádzky nastaveného pred vyšetrením MR, a to buď automaticky, ak bol nastavený parameter časového intervalu vypnutia, alebo manuálne pomocou programátora. Vykonajte kontrolné testovanie defibrilačného systému po opustení režimu MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) a pokračujte v monitorovaní pacienta, pokiaľ sa generátor impulzov nevráti k prevádzke pred MR.

UPOZORNENIE: Prítomnosť implantovaného defibrilačného systému môže spôsobovať artefakty na snímkach MR.

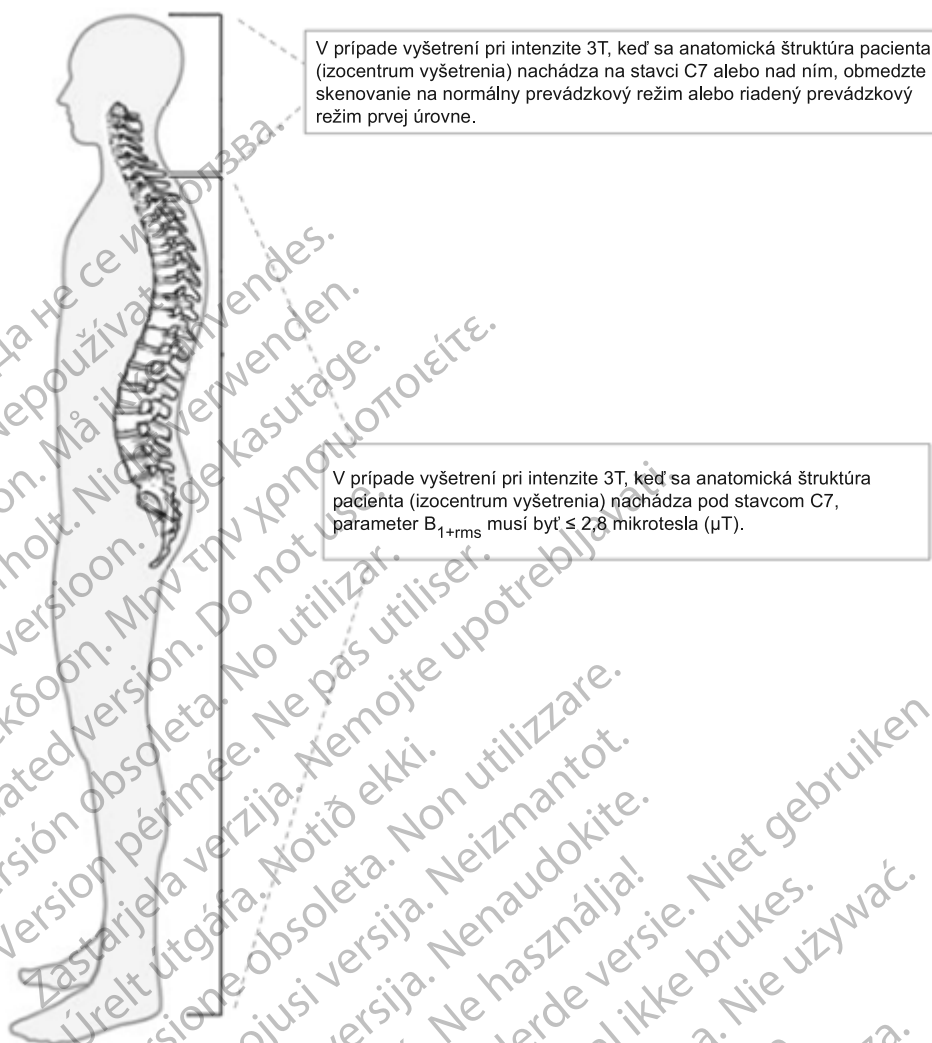

V prípade vyšetrenia pri intenzite 3 T, keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum vyšetrenia) nachádza na stavci C7 alebo nad ním, obmedzte skenovanie na normálny prevádzkový režim alebo riadený prevádzkový režim prvej úrovne. Keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum vyšetrenia) nachádza pod stavcom C7, parameter B_{1+rms} musí byť obmedzený na hodnotu $\leq 2,8$ mikrot Tesla (μT). Ak používate snímač, ktorý nezobrazuje parameter B_{1+rms} , neskenujte pri intenzite 3 T, keď sa anatomická štruktúra pacienta (izocentrum vyšetrenia) nachádza pod stavcom C7.

Obrázok B-1. Limitné parametre pri skenovaní MR s intenzitou 3 T.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht kasutage.
Αεγονυδ versioon. Μην την χρησιμοποιείτε.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsoleta. Ne utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versione expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

SÚČASTI DEFIBRILAČNÉHO SYSTÉMU IMAGEREADY PRE INTENZITY 1,5 T A 3 T

PRÍLOHA C

Iba špecifické kombinácie generátorov impulzov a elektród tvoria defibrilačný systém ImageReady, ktorý je možné používať pri vyšetrení na **snímačoch s intenzitou 1,5 T alebo 3 T**.

Šedé tieňovanie v riadkoch modelov označuje súčasti kompatibilné s oboma snímačmi s intenzitou 1,5 T a 3 T. Znak x označuje stav Podmienečne kompatibilné s prostredím MR pri uvedenej intenzite magnetického poľa.

Generátory impulzov CRT-D – súčasti defibrilačného systému ImageReady podmienečne kompatibilného s prostredím MR

Súčasť	Číslo modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
Generátory impulzov CRT-D				
AUTOGEN X4 CRT-D	G177, G179	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
AUTOGEN CRT-D	G172, G173	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
CHARISMA X4 CRT-D	G328, G348	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	G337, G347	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
CHARISMA CRT-D	G324, G325	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
DYNAGEN X4 CRT-D	G156, G158	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
DYNAGEN CRT-D	G150, G151	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
INOGEN X4 CRT-D	G146, G148	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
INOGEN CRT-D	G140, G141	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
MOMENTUM CRT-D X4	G128, G138	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
MOMENTUM CRT-D	G124, G125	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
ORIGEN X4 CRT-D	G056, G058	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
ORIGEN CRT-D	G050, G051	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	

Súčasť	Čísla modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
RESONATE HF CRT-D	G524, G525, G528, G548	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	G537, G547	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
RESONATE X4 CRT-D	G428, G448	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	G437, G447	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
RESONATE CRT-D	G424, G425	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
VIGILANT X4 CRT-D	G228, G248	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	G237, G247	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
VIGILANT CRT-D	G224, G225	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	

Generátory impulzov ICD – súčasti defibrilačného systému ImageReady podmiennečne kompatibilného s prostredím MR

Súčasť	Čísla modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
Generátory impulzov ICD				
AUTOGEN EL ICD	D174, D175, D176, D177	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
AUTOGEN MINI ICD	D044, D045, D046, D047	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
CHARISMA EL ICD	D320, D321	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	D332, D333	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
DYNAGEN EL ICD	D150, D151, D152, D153	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
DYNAGEN MINI ICD	D020, D021, D022, D023	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
INOGEN EL ICD	D140, D141, D142, D143	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
INOGEN MINI ICD	D010, D011, D012, D013	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
MOMENTUM EL ICD	D120, D121	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	

Súčasť	Čísla modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
ORIGEN EL ICD	D050, D051, D052, D053	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
ORIGEN MINI ICD	D000, D001, D002, D003	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
PERCIVA HF ICD	D500, D501	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	D512, D513	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
PERCIVA ICD	D400, D401	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	D412, D413	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
RESONATE HF ICD	D520, D521	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	D532, D533	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
RESONATE EL ICD	D420, D421	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	D432, D433	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
VIGILANT EL ICD	D220, D221	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
	D232, D233	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X

Elektródy a príslušenstvo – súčasti defibrilačného systému ImageReady podmienične kompatibilného s prostredím MR

Súčasť	Čísla modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
Elektródy a príslušenstvo				
Pravé predsieňové elektródy a príslušenstvo				
Stimulačné elektródy FINELINE II Sterox	4479, 4480	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Stimulačné elektródy FINELINE II Sterox EZ	4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Návleky na prísitie pre elektródy FINELINE II	6220, 6221	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Stimulačné elektródy INGEVITY MRI (fixácia hrotmi)	7735, 7736	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X

Súčasť	Čísla modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
Stimulačné elektródy INGEVITY MRI (vysúvateľná/zasúvateľná fixácia)	7740, 7741, 7742	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Návlek na prišitie pre elektródy INGEVITY MRI	6402	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Záslepka portu elektródy IS-1	7145	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Pravé komorové elektródy a príslušenstvo				
Elektródy ENDOTAK RELIANCE (IS-1) – jednocievkové	0128, 0138, 0170, 0171, 0180, 0181, 0182, 0183	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
Elektródy ENDOTAK RELIANCE (IS-1) – jednocievkové ^a	0127, 0129, 0137, 0139, 0172, 0173	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
Záslepka portu elektródy typu DF-1 pre elektródy ENDOTAK RELIANCE (IS-1) – jednocievkové	6996	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
Elektródy ENDOTAK RELIANCE (IS-1) – dvojcievkové	0148, 0157, 0158, 0174, 0175, 0176, 0177, 0184, 0185, 0186, 0187	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
Elektródy ENDOTAK RELIANCE (IS-1) – dvojcievkové ^a	0143, 0147, 0149, 0153, 0159	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
Defibrilačné elektródy ENDOTAK RELIANCE (DF4)	0262, 0263, 0265, 0266, 0272, 0273, 0275, 0276, 0282, 0283, 0285, 0286, 0292, 0293, 0295, 0296	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Defibrilačné elektródy RELIANCE 4-FRONT (DF4)	0636, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0657, 0658, 0662, 0663, 0665, 0672, 0673, 0675, 0676, 0682, 0683, 0685, 0686, 0692, 0693, 0695, 0696	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Návlek na prišitie pre elektródy RELIANCE 4-FRONT	6403	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Elektródy a príslušenstvo pre ľavú komoru				
Elektródy ACUITY Spiral	4591, 4592, 4593	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
Návlek na prišitie pre elektródy ACUITY Spiral ^a	6100	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
Stimulačné elektródy ACUITY X4 (IS4)	4671, 4672, 4674, 4675, 4677, 4678	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Návlek na prišitie pre elektródy ACUITY X4	4603	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Elektródy EASYTRAK 2 (IS-1)	4542, 4543, 4544	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	

Súčasť	Číslo modelov	Kompatibilita s prostredím MR	1,5 T	3 T
Návlek na prístup pre elektródy EASYTRAK 2	6773	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	
Záslepka portu elektródy IS4/DF4	7148	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	X
Záslepka portu elektródy IS-1	7145	Podmienečne kompatibilné s prostredím MR	X	

- a. Tieto zariadenia už nie sú dodávané na trh EÚ a už nenesú označenie CE. Spoločnosť Boston Scientific naďalej poskytuje podporu pre tieto zariadenia a ich systémy podmienečne kompatibilné s prostredím MR.

Остаряла версия. Да не се използва.
 Zastaralá verze. Nepoužívat.
 Forældet version. Må ikke anvendes.
 Version überholt. Nicht verwenden.
 Version obsolete. Ärge kasutage.
 Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
 Outdated version. Do not use.
 Versión obsoleta. No utilitzar.
 Version périmée. Ne pas utiliser.
 Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
 Úreilt útgáfa. Notið ekki.
 Versione obsoleta. Non utilizzare.
 Pasenusi versija. Neizmantot.
 Elavult versio. Ne használja!
 Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
 Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
 Wersja przeterminowana. Nie używać.
 Versão obsoleta. Não utilize.
 Versiune expirată. A nu se utiliza.
 Zastaraná verzia. Nepoužívať.
 Vanhentunut versio. Älä käytä.
 Föråldrad version. Använd ej.
 Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht kasutage.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.


SPRÁVY PROGRAMÁTORA DEFIBRILÁTORA PODMIENEČNE KOMPATIBILNÉHO S PROSTREDÍM MR

PRÍLOHA D

ZOOM® View™		Report Created 10 Apr 2017
Boston Scientific		MRI Protection Settings Report
Date of Birth	N/R N/R N/R	Last Office Interrogation 10 Apr 2017
Device	RESONATE HF CRT-D G547/ 268019AC7812624EFFFFFFF1	Implant Date N/R
Tachy Mode	Off	
MRI Protection Status		
MRI Protection Mode		On
MRI Protection Entry Time		10 Apr 2017 12:34
⚠ Patient must be out of MRI scanner before 10 Apr 2017 18:34		
Settings During MRI Protection		
Parameter	Old Value	New Value
Tachy Mode	Monitor + Therapy	Off
Brady Mode	DDD	DOO
Lower Rate Limit	45 min ⁻¹	65 min ⁻¹
AV Delay	180 - 180 ms	100 ms
Ventricular Pacing Chamber	Biv	Biv
Pacing Output		
Atrial	3.5 V @ 0.4 ms	5.0 V @ 1.0 ms
Right Ventricular	3.5 V @ 0.4 ms	5.0 V @ 1.0 ms
Left Ventricular	3.5 V @ 0.4 ms	3.5 V @ 0.4 ms
Page 1 of 4		
ZOOM® View™		10 Apr 2017 11:06
MRI Protection Settings Report		
Settings During MRI Protection (Continued)		
LV Offset	0 ms	0 ms
The following features are suspended during MRI Protection:		
RA Automatic Threshold		
RV Automatic Threshold		
LV Automatic Threshold		
Daily diagnostics		
Magnet detection		
RF Telemetry		
i	Beeper is disabled due to MRI Protection Mode usage. Coming in contact with the strong magnetic field of an MRI scanner causes a permanent loss of the beeper volume. For a list of situations that will no longer trigger the beeper to emit audible tones, reference the MRI Technical Guide.	
Leads Data	Pre-MRI Scan Measurement	Measurement Date
Atrial		
Intrinsic Amplitude	2.3 mV	10 Apr 2017 11:02
Pace Impedance	547 Ω	10 Apr 2017 11:06
Pace Threshold	1.8 V @ 0.4 ms	10 Apr 2017 11:03
Right Ventricular		
Intrinsic Amplitude	4.3 mV	10 Apr 2017 11:02
Page 2 of 4		

[1] Používa sa 24-hodinový formát času. [2] Stĺpec Dátum merania udáva dátum, kedy boli zhromaždené údaje o elektródach, čo môže byť pred dátumom samotnej správy o ochrane MR.

Obrázok D-1. Ukážka výtlačku správy s nastaveniami MRI Protection (Ochrana MR) s časovým intervalom nastaveným na 6 hodín (strany 1-2)

	ZOOM® View™		Report Created 10 Apr 2017
	MRI Protection Settings Report		
	Date of Birth	N/R N/R N/R	Last Office Interrogation
	Device	RESONATE HF CRT-D G547/268019AC7812624EFFFFFFF1	10 Apr 2017 Implant Date N/R
Tachy Mode	Off		

MRI Protection Status

MRI Protection Mode On
 MRI Protection Entry Time 10 Apr 2017 12:36

▲ MRI Protection will stay "On" until reprogrammed by a trained professional.

Settings During MRI Protection

Parameter	Old Value	New Value
Tachy Mode	Monitor + Therapy	Off
Brady Mode	DDD	DOO
Lower Rate Limit	45 min ⁻¹	65 min ⁻¹
AV Delay	180 - 180 ms	100 ms
Ventricular Pacing Chamber	BiV	BiV
Pacing Output		
Atrial	3.5 V @ 0.4 ms	5.0 V @ 1.0 ms
Right Ventricular	3.5 V @ 0.4 ms	5.0 V @ 1.0 ms
Left Ventricular	3.5 V @ 0.4 ms	3.5 V @ 0.4 ms

Page 1 of 4

Obrázok D-2. Ukážka výtlačku správy s nastaveniami MRI Protection (Ochrana MR) s časovým intervalom vypnutia nastaveným na Off (Vyp.) (strana 1)

Event MRI-5: 10 Apr 2017 12:34

Settings During MRI Protection

Tachy Mode	Off
Brady Mode	DOO
Lower Rate Limit	65 min ⁻¹
AV Delay	100 ms
Ventricular Pacing Chamber	BiV
Pacing Output	
Atrial	5.0 V @ 1.0 ms
Right Ventricular	5.0 V @ 1.0 ms
Left Ventricular	3.5 V @ 0.4 ms
LV Offset	0 ms
MRI Protection Time-out	6 h

Leads Data (most recent pre-MRI scan measurements)

Atrial		
Intrinsic Amplitude	2.3 mV	10 Apr 2017 11:02
Pace Impedance	548 Ω	10 Apr 2017 12:34
Pace Threshold	1.8 V @ 0.4 ms	10 Apr 2017 11:03
Right Ventricular		
Intrinsic Amplitude	4.3 mV	10 Apr 2017 11:02
Pace Impedance	549 Ω	10 Apr 2017 12:34
Pace Threshold	1.4 V @ 0.4 ms	10 Apr 2017 11:03
Left Ventricular		
Intrinsic Amplitude	4.2 mV	10 Apr 2017 11:02
Pace Impedance	311 Ω	10 Apr 2017 12:34
Pace Threshold	1.5 V @ 0.4 ms	10 Apr 2017 11:04
Shock		
Impedance	47 Ω	10 Apr 2017 12:34
MRI Protection Exit Status	User Terminated	
MRI Protection Exit Time	10 Apr 2017 12:35	

Event Ended 00:00:52

Pre zariadenia RESONATE HF, RESONATE, PERCIVA HF, PERCIVA, CHARISMA, VIGILANT a MOMENTUM






Obrázok D-3. Ukážka výtlačku uloženej udalosti

SYMBOLY NA BALENÍ

PRÍLOHA E

Na obaloch a štítkoch môžu byť použité nasledujúce symboly.

Tabuľka E-1. Symboly na balení

Symbol	Popis
	Značka CE zhody s identifikáciou príslušného úradu, ktorý schvaľuje používanie značky
	Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve
	Výrobca
	Podmienečne kompatibilný s prostredím MR
	Referenčné číslo

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version outdated. Μην την χρησιμοποιείτε.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsolete. Ne utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Neizmantot.
Novecoјusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versione expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

REGISTER

Symboly

„Zabudnuté“ elektródy alebo generátory impulzov 1-6

A

ACUITY Spiral 1-2
ACUITY X4 1-2
Aktívne implantovateľné medicínske zariadenia (AIMD) 1-9
AUTOGEN 1-2

C

Čas uplynutý od implantácie 2-10
CHARISMA 1-2
Cievky 1-9
prijímacie 1-7
vysielacie 1-7
vysielacie/prijímacie 1-7

D

Defibrilačný systém ImageReady podmienene kompatibilný s prostredím MR 1-6
Defibrilačný systém ImageReady podmienene kompatibilný s prostredím MR 1-2
DIVERT THERAPY 2-13
DYNAGEN 1-2

E

EASYTRAK 2 1-2
Elektródy
ACUITY X4 1-2
Elektródy
ACUITY Spiral 1-2
EASYTRAK 2 1-2
ENDOTAK RELIANCE 1-2
FINELINE II 1-2
INGEVITY MRI 1-2
RELIANCE 4–FRONT 1-2
ENDOTAK RELIANCE 1-2
Epizóda ochrany pri MR 2-13

F

FINELINE II 1-2
Funkcia bezpečnostného stavu Safety Core 2-4

G

Generátory impulzov
AUTOGEN 1-2
CHARISMA 1-2
DYNAGEN 1-2
Generátory impulzov
MOMENTUM 1-2
INOGEN 1-2
ORIGEN 1-2
PERCIVA 1-2
PERCIVA HF 1-2
RESONATE 1-2
RESONATE HF 1-2
VIGILANT 1-2

H

Hlavica programátora 2-4, 2-8, 2-13

I

Impedancia elektródy 2-3, 2-10, 2-13–2-14
INGEVITY MRI 1-2
INOGEN 1-2
Integrita systému 2-13
narušená 1-6
Intenzita magnetického poľa systému MR
1,5 T 1-2
1,5 tesla 1-2, 1-7, 1-9
3 T 1-2
3 tesla 1-2, 1-7, 1-9

K

Komorová epizóda 2-9
Konfigurácia nastavení zvukovej signalizácie 2-15
Kontrolný kardiologický zoznam A-1
Kontrolný rádiologický zoznam B-1

L

Limity miery SAR 1-7
Limity špecifickej miery absorpcie (SAR) 1-7

M

Minútová ventilácia 2-15
Modely, ktoré možno použiť so systémom s intenzitou 1,5 T 1-2

Modely, ktoré možno použiť so systémom
s intenzitou 3 T 1-2
MOMENTUM 1-2
Monitorovanie pacienta 1-6, 2-8
MRI Protection Checklist (Kontrolný zoznam ochrany
pri MR) 2-5
MRI Protection Mode (Režim ochrany pri MR) 1-6, 1-
9
 automatické ukončenie 2-13
 Funkcia časového intervalu vypnutia 1-2, 2-3, 2-9,
 2-13–2-14
 manuálne ukončenie 2-13
 podmienky zabraňujúce vstupu 2-9

N

Normálny prevádzkový režim 1-7

O

Ochrana pred tachykardiou 1-6
ORIGEN 1-2

P

PERCIVA 1-2
PERCIVA HF 1-2
Poloha pacienta 1-7, 2-12
Prevádzkový režim
 normálny 1-7
Prijímacie cievky 1-7
Programátor 1-2
Pulzná oxymetria 2-12
Pulzová oxymetria 1-7

R

RELIANCE 4–FRONT 1-2
RESONATE 1-2
RESONATE HF 1-2
Režim elektrokauterizácie 2-4
Režim ochrany pri MR 2-4
 automatické ukončenie 2-13
 Funkcia časového intervalu vypnutia 2-2, 2-7, 2-12
 manuálne ukončenie 2-8
 podmienky zabraňujúce vstupu 2-4
 pozastavené vlastnosti a funkcie 2-3
 vstup do 2-4
Režim ochrany Pri MR
 manuálne ukončenie 2-8
Režim skladovania 2-4, 2-10
Režim STAT PACE 2-9
Režim STAT SHOCK 2-9
RF telemetria 2-3, 2-13
RF Telemetria 2-4

S

Senzor magnetu 2-9
Šesť týždňov od implantácie 1-6, 1-13
Skreslenie obrazu 2-12
Správa s nastaveniami ochrany pri MR 2-2
Správa s nastaveniami režimu ochrany Pri MR 2-8
Správy D-1
STAT PACE 2-13
STAT SHOCK 2-13
Stav kapacity batérie 2-4
Stimulačný prah 2-13–2-14
Stručná referenčná príručka C-1

T

Tesla
1,5 T 1-2, 1-7, 1-9
3 T 1-2, 1-7, 1-9

U

Uzatvorený priechod 1-7

V

VIGILANT 1-2
Vlastná amplitúda 2-3, 2-13–2-14
Vysielacie cievky 1-7
Vysielacie/prijímacie cievky 1-7

Z

Záznamy arytmií 2-13
Zlomená elektróda 1-6
Zmeny stimulačného prahu 1-13
Zvuková signalizácia 2-11, 2-15

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Myn þyn Χρησιμοποιείτε.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Novecojsi versija. Non utilizzare.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

www.bostonscientific.com

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

© 2019 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All rights reserved.

360205-050 SK Europe 2019-12

CE 2797

Nasledujúce zariadenia už nie sú k dispozícii na trhu v EÚ a už
nesú aktívne označenie CE: 0127, 0129, 0137, 0139, 0143, 0147,
0149, 0153, 0159, 0172, 0173, 6100.

